WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	78/19/12/2024/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8526
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne BAC SIRIO
Nr seryjny:	17101
Data sporządzenia wyceny:	13-01-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 30.12.2024 r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Worów 50B, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne BAC SIRIO do głębokiej stymulacji kawitacyjnej. Przeznaczona do terapii ostrych stanów zapalnych, zwapnienia ścięgien, urazów więzadeł, zwłóknienia mięśni, obrzęków. Znajduje zastosowanie w branży medycznej.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	BAC
Model:	SIRIO
Numer seryjny:	17101
Rok produkcji:	-
Przebieg:	-
Zasilanie:	230 V
Moc maksymalna:	3 W/cm^2
Częstotliwość:	38 kHz
Maksymalny czas zabiegu:	30 minut
Waga urządzenia:	2,5 kg
Wyposażenie:	Głowica płaska impulsowa Głowica wklęsła impulsowa Zasilacz

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Podłączono również głowice – brak reakcji po podłączeniu do prawego wejścia na głowice. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- głowice – starcie powierzchni,

- po podłączeniu jednej z głowic wyświetla się komunikat o pozostałym czasie 2 godziny,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano paszportu technicznego, historii serwisowania, eksploatacji.

Stan urządzenia określa się jako dostateczny.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.


SIRIO BAC




SIRIO BAC
SIRIO
BACTECHNOLOGY


BAC srl
Model: SIRIO
P/n: 990701 S/n: 17101
Power Supply:
24V 2.9A
CE
0051
MADE IN ITALY



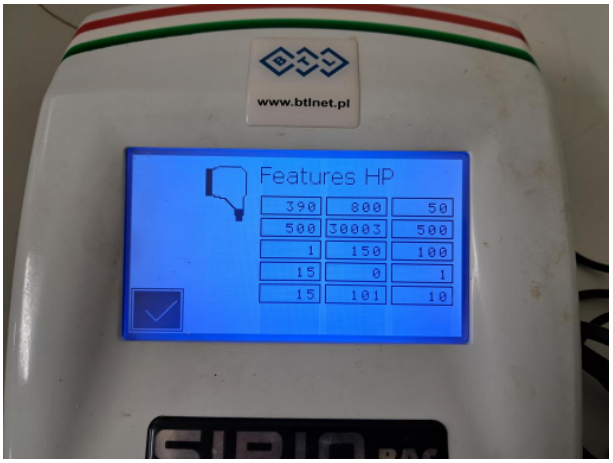




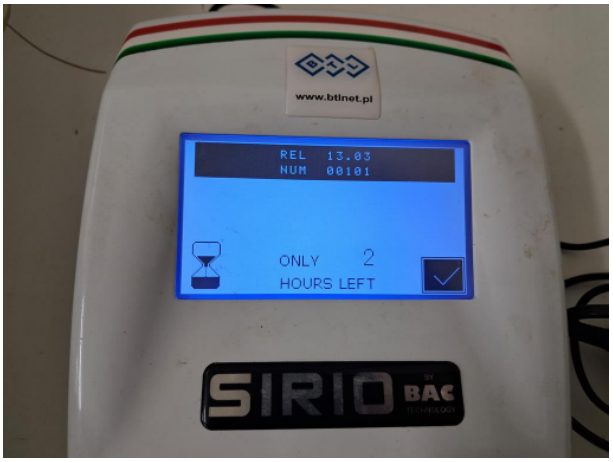

www.btlnet.pl
SIRIO
MEDICAL
SIRIO BAC


www.btlnet.pl
0
SIRIO BAC


www.btlnet.pl
REL 13.03
NUM 00101


www.btlnet.pl
Features HP
390 800 50
500 30003 500
1 150 100
15 0 1
15 101 10


www.btlnet.pl
ON
POWER % 40
TIME 20 00
SIRIO BAC


www.btlnet.pl
REL 13.03
NUM 00101
ONLY 2
HOURS LEFT
SIRIO BAC


SIEMENS