WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	32/22/10/2024/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8507
Wykonawca:	Piotr Bałaziński
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne Vision Medical Smart Graft F.U.E
Nr fabryczny:	SGB1128



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 24-11-2024r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Worów 15.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne Vision Medical Smart Graft F.U.E. SmartGraft wykorzystuje technologię FUE (ekstrakcja jednostek mieszków włosowych), która może być jednym z prostych rozwiązań w przypadku wypadania włosów zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet. System SmartGraft został opracowany, aby zapewnić pacjentom alternatywę dla widocznych blizn liniowych, które występują w przypadku tradycyjnej metody paskowej.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	Vision Medical
Model:	Smart Graft F.U.E.
Numer fabryczny:	SGB1128
Rok produkcji:	2020
Czas pracy:	-
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Włącznik nożny Adapter głowicy, numer seryjny 19K0181 Końcówka głowicy Bier Air

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie uruchomiło się – nie wykonano próby działania. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono niewielkie ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Wyposażenie zabiegowe zostało zdemontowane i znajduje się w rękawach do sterylizacji z datą 19-10-2020, wyposażenie wymaga ponownej sterylizacji przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji urządzenia. Podczas oględzin nie było możliwości weryfikacji kompletności wyposażenia, mogą występować braki.

Stan urządzenia określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania, paszportu technicznego, deklaracji zgodności WE. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.


SIEMENS
8507










SIEMENS


MIESIĄC:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MODEL SMARTGRAFT F.U.E.
TYPE E-B 220
SERIAL NO. SGB1128
SUPPLY VOLTAGE 110-240 VAC
FREQUENCY 50-60 Hz
POWER 385-770 VA
FUSE 2x10A/250V FAST
MASS 65.6 KILOGRAMS
CONFORMANCE TO EU DIRECTIVE 93/42/EEC IEC60601 - 1 - 2: 2014
DESIGNED AND MANUFACTURED BY:
VISION MEDICAL, INC.
46 REGENCY PLAZA
GLEN MILLS, PA 19342
TEL.: 610-680-7676
SALES@SMARTGRAFT.COM
CE RoHS2
FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE.
CAUTION! READ USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS DEVICE.
WARNING! ELECTRICITY! DO NOT REMOVE COVER. DO USE ONLY GROUNDED OUTLETS.
MADE IN THE U.S.A. PATENT PENDING


PREP
Chiller
Off
10°c
Chiller Light
Off
Shower Tube
Load
Locked
Chiller Temp 13°c
Next >>


SIEMENS
8507
NAZWA
MARKA/MODEL
Urządzenie VISION MEDICAL Smart Graft
NR VIN/SERYJNY
SG81128
ROK PRODUKCJI
2020
NR REJESTRACYJNY


SIEMENS
NAZWA
MARKA/MODEL
Urządzenie VISION MEDICAL Smart Graft
8507
16027
NR VIN/SERYJNY
SGB1128
ROK PRODUKCJI
2020


Total Count
1201
0:00
Vacuum
Off
0%
Handpiece
Off
0 RPM
Handpiece Light
Off
45%
Graft Shower
Off
2 Min
Chiller Temp 13°c




PREMIER CAT. NO. P32-S
NEMA & UL ENCLOSURE TYPE 1
c UL us 20A 1HP 125-250 VAC ~
20(3)A 250V ~ 50/60 HZ
LISTED 1/2A 125 VDC, 1/4A 250 VDC ⎓
IND CONT EQ. μ 1E5 IP20
690B LINEMASTER SWITCH CORPORATION
WOODSTOCK, CT USA
CE
Id


FACTORY DIRECT PRICING
(860) 974-1000
www.linemaster.com


4a medical
Steam Chemical Integrator
DARK BAR MUST PASS THIS POINT
LOT


4a medical
producing health for the world
LOT : C50520
: 2024.05
REF 338746 ISO 11140-1 Class 5
Steam Chemical Integrator
ACCEPT
DARK BAR MUST
PASS THIS POINT




CE
0120
135°C
1600755
SN19K0181

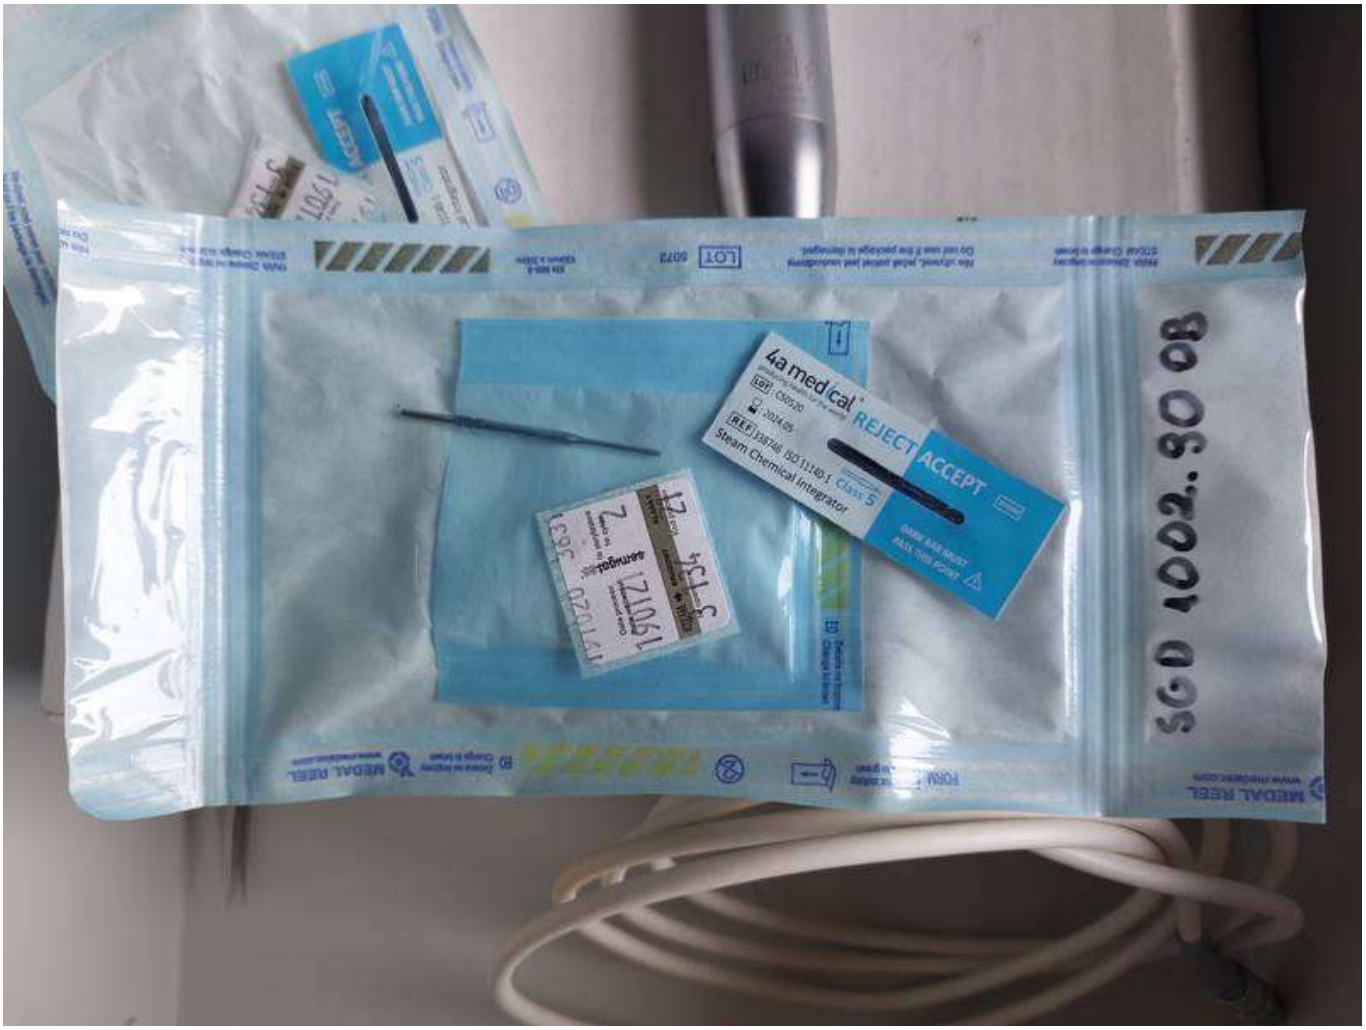
4a medical
REJECT
ACCEPT
Steam Chemical Integrator
SCD 1002.30 08

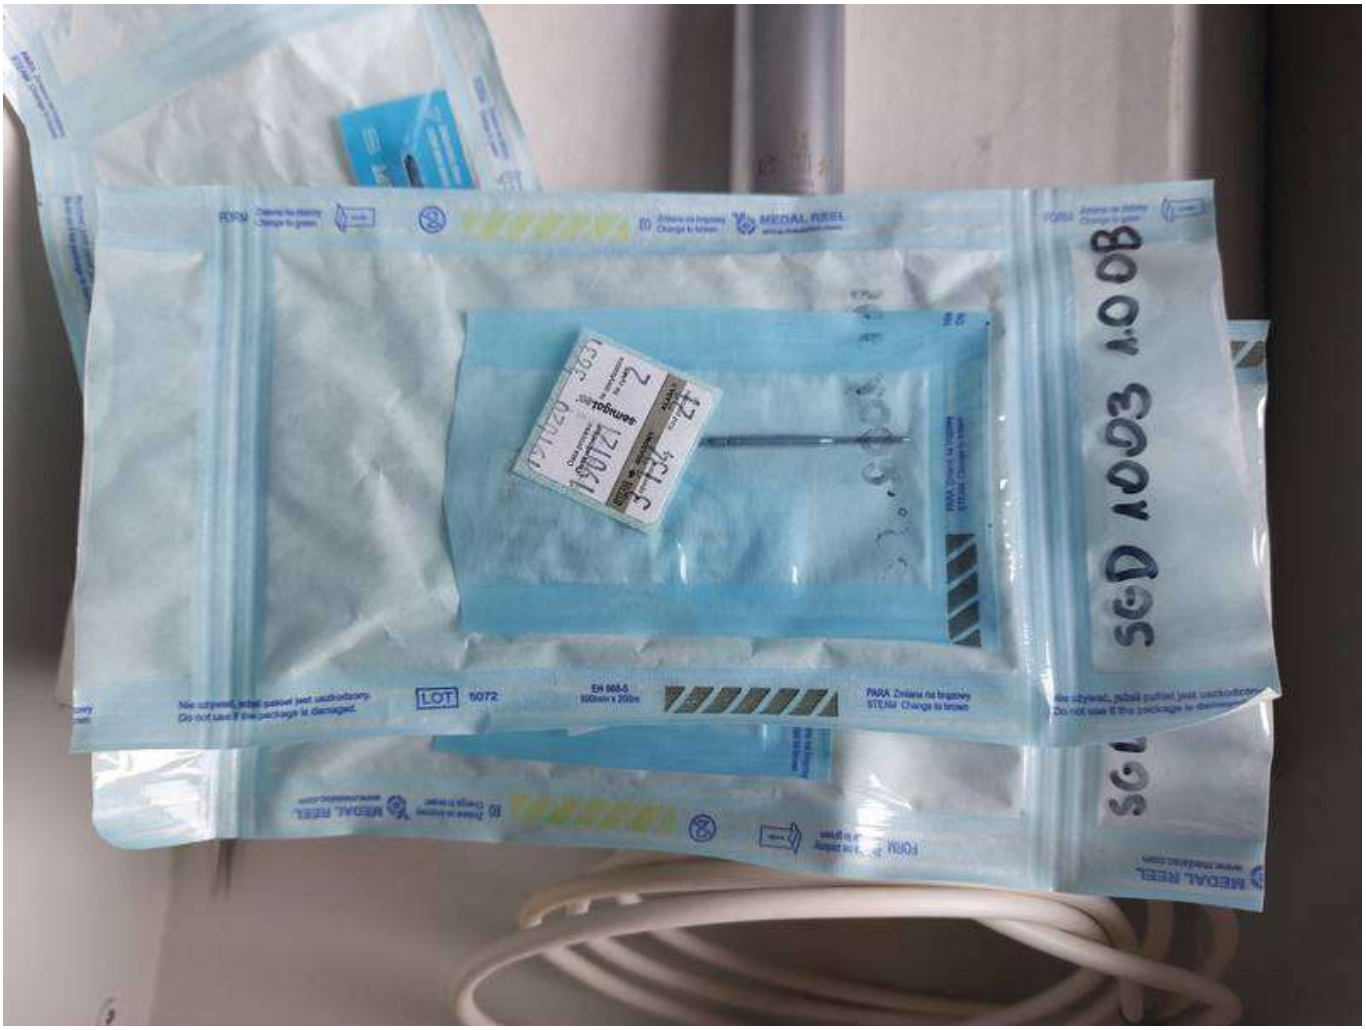
MEDAL REEL
LOT 5072
SCD 1003 1008


EJECT ACCEPT


MEDAL REEL
4a medical
REJECT
ACCEPT
LOT 5072
Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony.
Do not use if the package is damaged.


MEDAL REEL
LOT 5072
EN 868-5



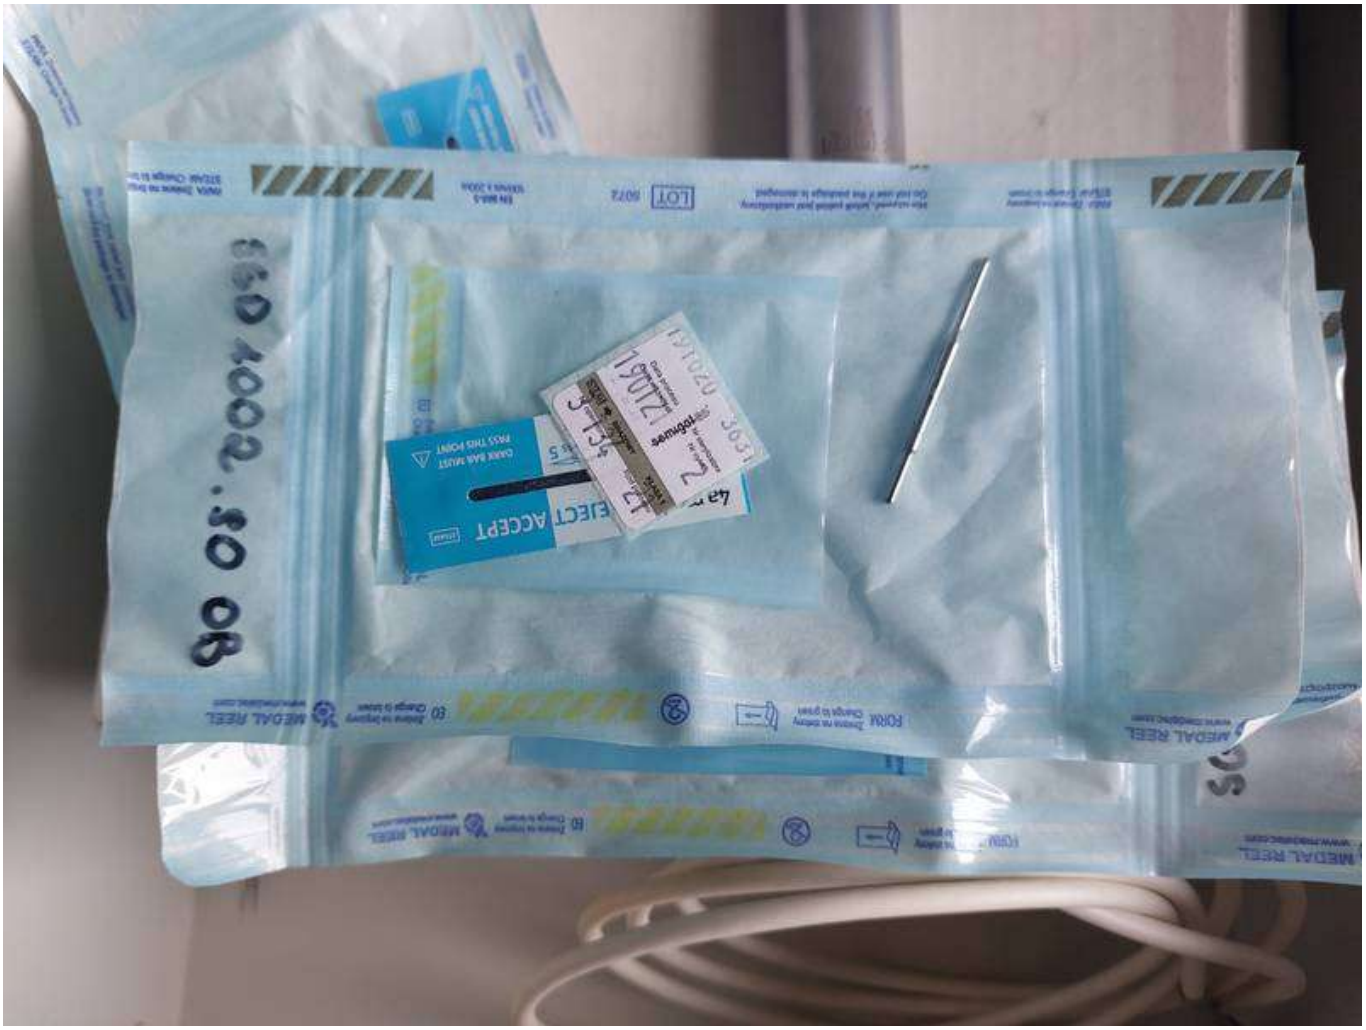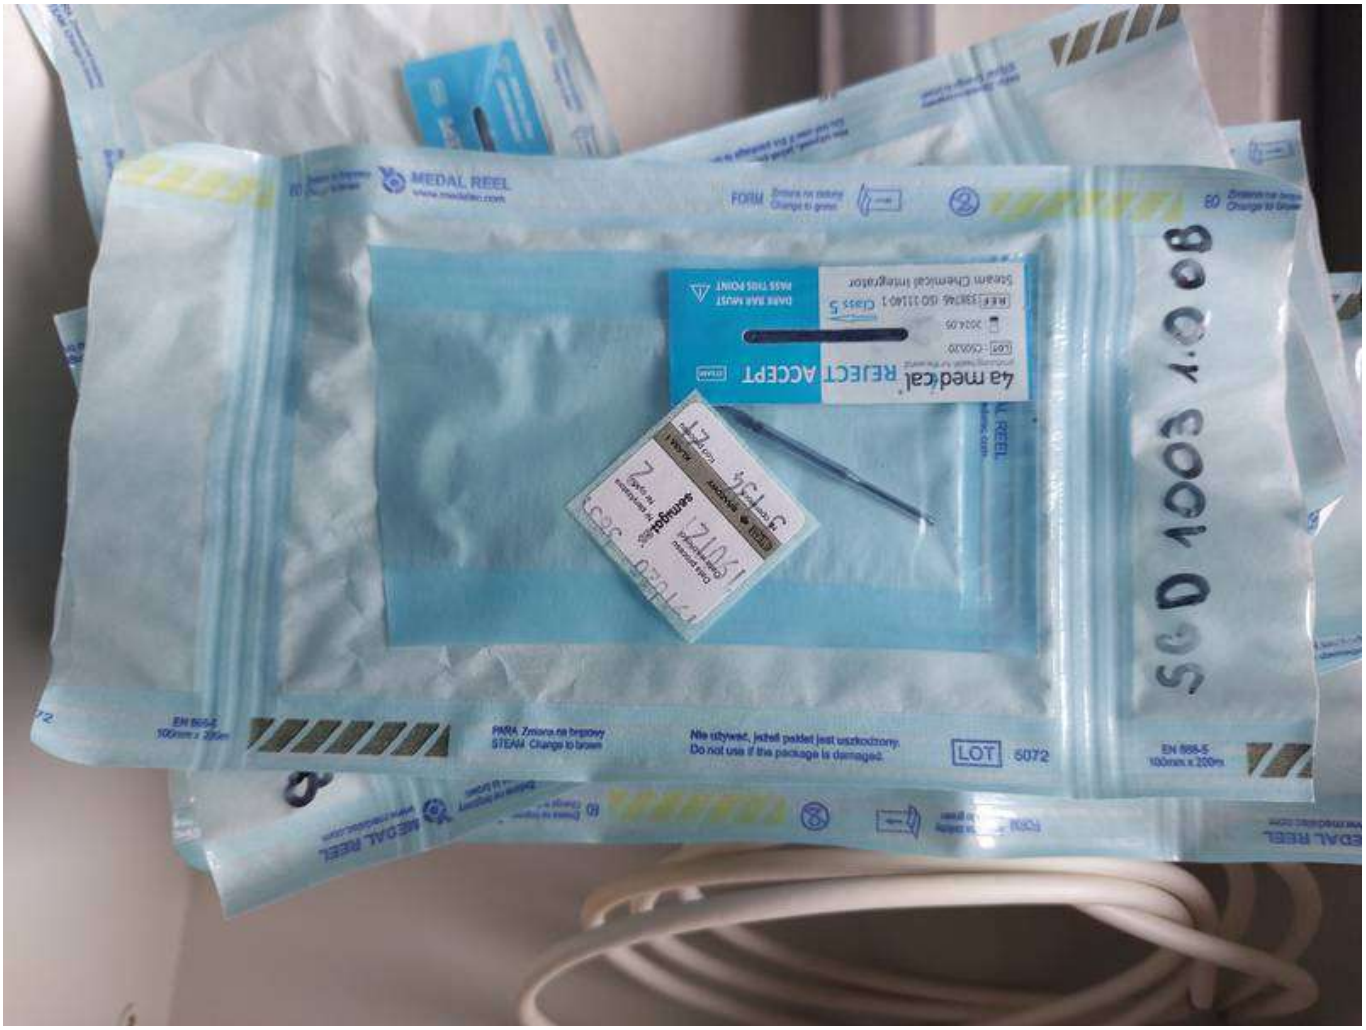
LOT
191020 3631
Data procesu
Data ważności
Nr sterylizatora
Nr cyklu
190121 2
STEAM
BRĄZOWY
KLASA 1
Nr operatora
Kod procesu
3134 21
MEDAL REEL






MEDAL REEL

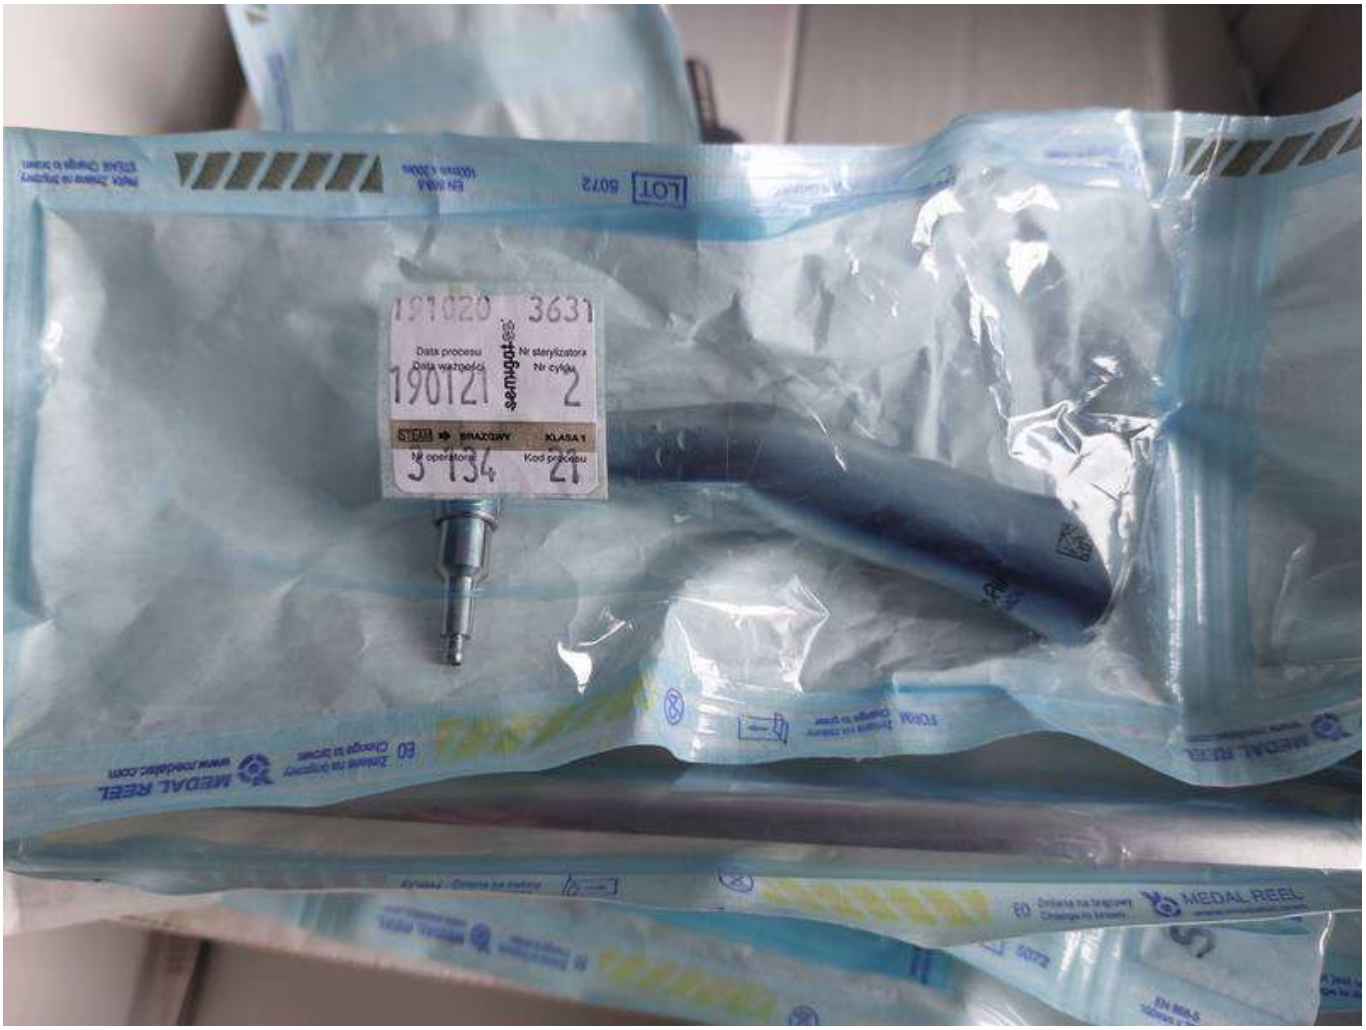