WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	119/02/04/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8705
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne EMS Physio Primo Shockwave EMS 560 (BiShock)
Nr fabryczny:	2401342
Data sporządzenia wyceny:	10-04-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 09.04.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne EMS Physio Primo Shockwave EMS 560, dzięki wykorzystaniu technologii fali akustycznej stymuluje naturalne procesy regeneracji skóry, przyspieszając produkcję kolagenu i elastyny. Możliwość modelowania sylwetki i redukcji cellulitu na różnych partiach ciała, takich jak: brzuch, uda, pośladki czy ramiona.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	EMS Physio
Model:	Primo Shockwave EMS 560
Nazwa handlowa:	BiShock
Numer fabryczny:	2401342
Rok produkcji:	-
Energia impulsu:	60-180 mJ
Częstotliwość pulsacji:	8,10,15 lub 22 Hz
Aplikatory:	6mm, 15mm, 25mm
Żywotność głowicy:	2 000 000
Wymiary jednostki głównej:	333x237x100 mm
Waga:	4,5 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Baza zasilająca Primo Shockwave PSU EMS559, nr seryjny: 2401352 Głowica EMS561, nr seryjny 2401362 Podstawa na głowicę Włącznik nożny Żel USG

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Głowicę podłączono do urządzenia, nie wykonywano próby działania. Urządzenie reaguje na sterowanie, dokonano przejścia przez menu. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych – ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono niewielkie ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Stan urządzenia określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano paszportu technicznego, deklaracji zgodności WE. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Brak informacji odnośnie gwarancji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcję obsługi

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.












EMS Physio Ltd.
Wantage, Oxfordshire, OX12 9FE, UK.
www.emsphysio.co.uk
1639 0120
Primo Shockwave
EMS560
Made in the UK
2401342
Not intended for continuous operation - duty cycle 2.5 minutes @ full power / 20 minutes off
Power in
48V
5A MAX
Use EMS Physio power supply Ref EMS559
Class 1 Type BF
IPX1


EMS Physio Ltd
Primo Radial Shockwave 560
Sales: Tel +44 1235 772272
Service: Tel +44 1235 774168
Web: www.emsphysio.co.uk
SN 2401342
83828
83828
7152
SBC version: 2.42
Total Energy
0 mJ/mm²
Treatments


EMS Physio Ltd.
Wantage, Oxfordshire, OX12 9FE, UK.
www.emsphysio.co.uk
1639 0120
Primo Shockwave PSU
EMS559
Made in the UK
2401352
Not intended for continuous operation - duty cycle 2.5 minutes @ full power / 20 minutes off
Input 100-240VAC 5A Max 50-60Hz Output 48V DC 9A MAX
Use with EMS560 Radial shockwave device
Class 1 Type BF
IPX1




Primo
radial shockwave



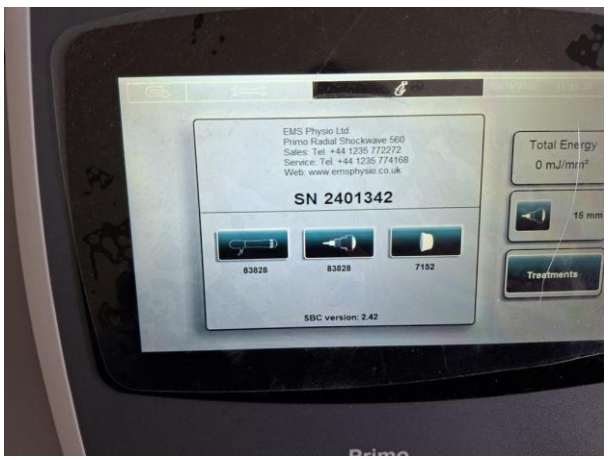



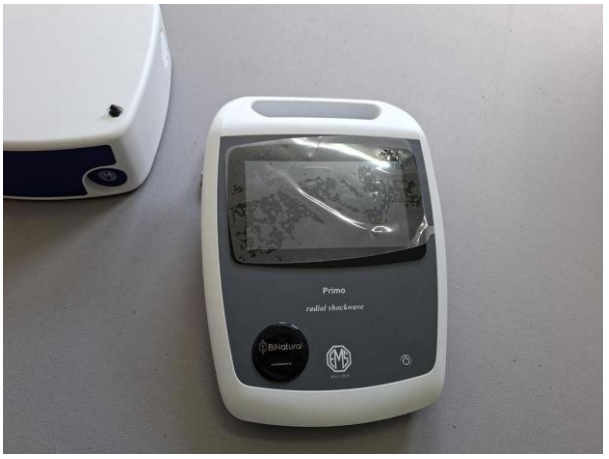



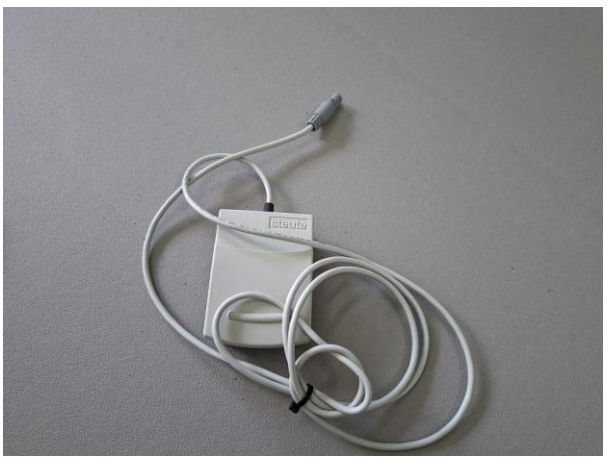


THERASONIC
ULTRASOUND TRANSMISSION GEL





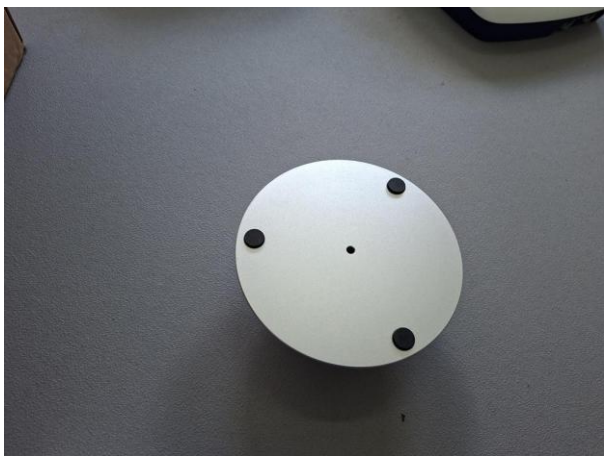


Primo
radial shockwave


Reset Counter
0
Set shocks
300
300
120 mJ
8 Hz
Freq
Burst
Primo
radial shockwave


Plantar fasciitis
Heel spurs
User program 1
User program 5
Tennis elbow
User program 2
User program 6
Achilles tendinopathy
Patellar tendinopathy
User program 3
User program 7
Myofascial pain
Lateral epicondylitis
User program 4
User program 8
Primo
radial shockwave


Reset Counter
0
Set shocks
300
300
120 mJ
8 Hz
Freq
Burst
Primo
radial shockwave


EMS561 Radial Shock
FOR USE WITH MODEL 13
2401362

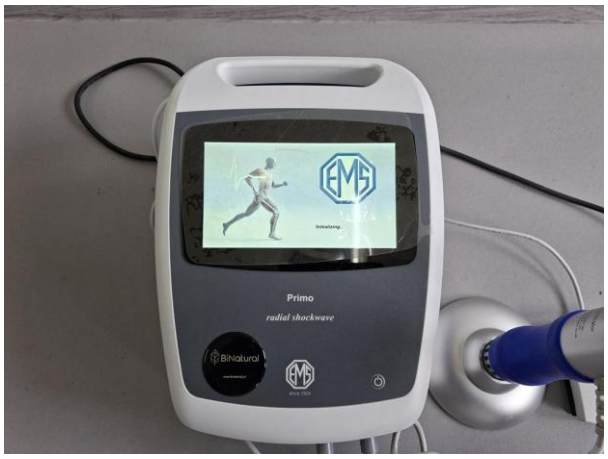
561 Radial Shockwave
FOR USE WITH MODEL 135 (EM
Sn: 2401362


User Manual
EMS560
PRIMO RADIAL SHOCKWAVE
Model 135
CE
1639