eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



WETERYNARYJNY ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY URIT-2900 VET PLUS

Zamawiający wycenę:	**Siemens Finance Sp. z o.o.** **ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa**
Numer zlecenia:	28/09/07/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8783
Nr fabryczny:	2900VETPET-03241
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 10.07.2026r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest weterynaryjny analizator hematologiczny URIT-2900VET PLUS. Jest to zaawansowane urządzenie medyczne, które oferuje pełną automatyzację i precyzję w analizie krwi zwierząt. Umożliwia oznaczenie 21 parametrów, wyposażony w zaprogramowane profile dla 13 gatunków zwierząt.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Weterynaryjny analizator hematologiczny
Producent:	URIT
Typ/model:	URIT-2900Vet Plus
Numer fabryczny:	2900VETPET-03241
Czas pracy:	Brak
Rok produkcji:	2020

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Gatunki:	Pies, kot, koń, świnia, krowa, bawół, królik, małpa, szczur, mysz, owca, koza, wielbłąd + 3 zdefiniowane przez użytkownika
Parametry:	WBC, LYM%#, MID%#, GRAN%#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR
Zasada działania:	Analiza WBC/HGB/PLT: metoda impedancji; Analiza HGB:kolorymetryczna, odczynniki bez cyjankowe
Odczynniki:	Diluent, Detergent, Lizat
Tryb testowy:	Krew pełna i rozcieńczona
Objętość próbki:	Krew pełna: 10 µl; rozcieńczona 20 µl
Wydajność:	Do 30 testów/h
Pamięć:	Do 100 tys. wyników z histogramami
Zasilanie:	230V
Wyposażenie:	Drukarka termiczna Mysz + Klawiatura Przewód zasilający

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Po uruchomieniu konieczne zalogowanie aby przejść do dalszych funkcji. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w warunkach pracy.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego –zarysowania, zabrudzenia itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- obudowa – starcie powłoki lakierowej, zarysowania,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano paszportu technicznego, historii serwisowania, eksploatacji. Brak informacji odnośnie ważnego przeglądu technicznego.

Stan urządzenia określa się jako dostateczny.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcję obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA







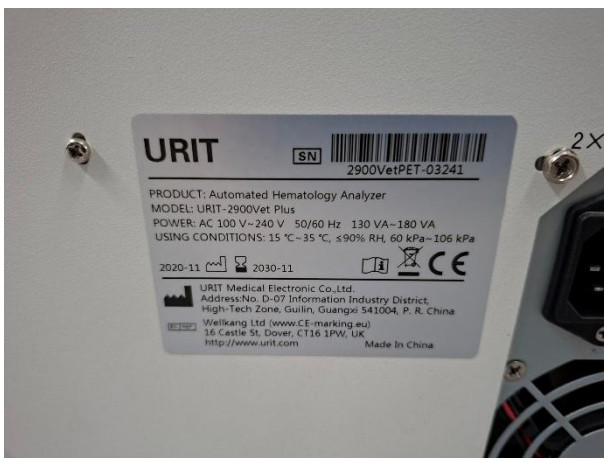
URIT
SN
2900VetPET-03241
PRODUCT: Automated Hematology Analyzer
MODEL: URIT-2900Vet Plus
POWER: AC 100 V~240 V 50/60 Hz 130 VA~180 VA
USING CONDITIONS: 15 ℃~35 ℃, ≤90% RH, 60 kPa~106 kPa
2020-11
2030-11
URIT Medical Electronic Co.,Ltd.
Address:No. D-07 Information Industry District,
High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P. R. China
Wellkang Ltd (www.CE-marking.eu)
16 Castle St, Dover, CT16 1PW, UK
http://www.urit.com
Made In China
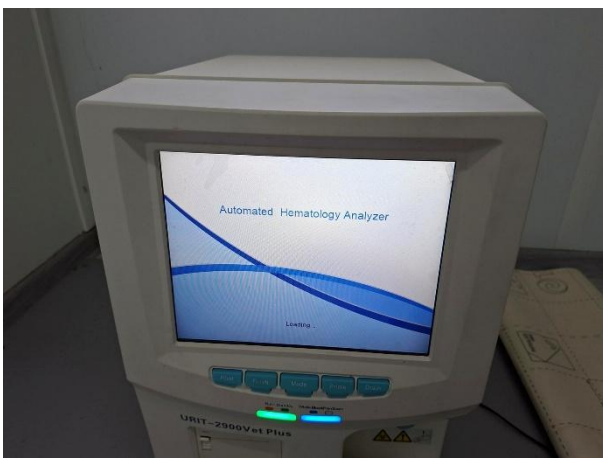
Automated Hematology Analyzer
URIT-2900Vet Plus


URIT
URIT-2900Vet Plus


Print
Flush
Mode
Prime
Drain
URIT-2900Vet Plus










URIT-2900Vet Plus


URIT-2900Vet Plus


Print
Flush
Mode
Prime
Drain
URIT-2900Vet Plus











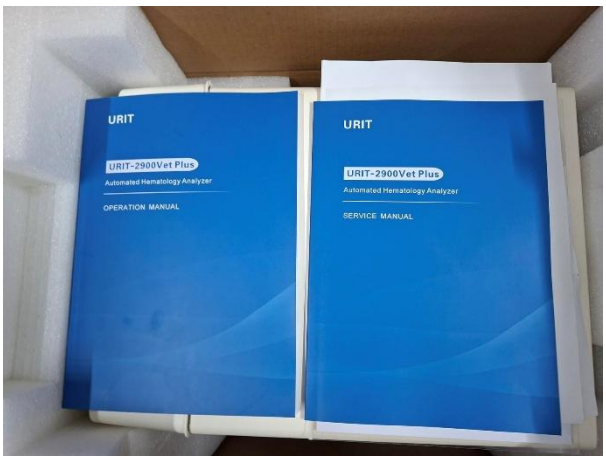
URIT
URIT-2900Vet Plus
Automated Hematology Analyzer
OPERATION MANUAL
URIT
URIT-2900Vet Plus
Automated Hematology Analyzer
SERVICE MANUAL