WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	31/01/06/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	7737
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Laser stomatologiczny Fotona LightWalker ATS
Nr seryjny:	20691368
Data sporządzenia wyceny:	09-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 03.06.2026 r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest laser stomatologiczny Fotona LightWalker AT-S. Urządzenie łaczy w sobie dwa typy laserów. Pierwszy z laserów to laser Er:YAG, cechujący się największą prędkością borowania w tkance twardej. Drugi system to laser Nd:YAG, pozwalający na precyzyjne zabiegi w obrębie tkanek miękkich. Dodatkową zaletą jest możliwość zastosowania tego lasera w endodoncji, chirurgii oraz zabiegach medycyny estetycznej.

Zastosowanie:

Er: YAG

- Przygotowywanie ubytków
- Periodontologia
- Ortodoncja
- Chirurgia

Nd: YAG

- Endodoncja
- Periodontologia
- Ortodoncja
- Chirurgia
- Wybielanie zębów

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Laser stomatologiczny
Producent:	Fotona
Model:	LightWalker AT-S
Numer seryjny:	20691368
Rok produkcji:	2020
Przebieg:	Całkowita liczba strzałów: 394835
Zasilanie:	230 V
Typ, długość fali, tryb pracy (ciągły/impulsowy):	laser Er:YAG (2940 nm), laser Nd:YAG (1064 nm), tryb pracy: impulsowy
Moc:	Laser Er:YAG: 20 W, laser Nd:YAG: 15 W
Czas impulsu:	SSP (50 µs), MSP (100 µs), SP (300 µs), LP (600 µs), VLP (1000µs), tryb SMOOTH, tryb QSP i tryb MAX
Wiązka pilotująca (długość fali, moc):	Półprzewodnikowy laser diodowy o długości 520 lub 532 nm, moc maks. 1 mW
Przewodzenie wiązki do tkanki (typ światłowodu):	Tytanowe głowice kontaktowe i bezkontaktowe, końcówki światłowodowe TIPS, światłowody do modułu Nd:YAG 200 µm i 300 µm
Wymiary:	55 x 29 x 82 cm

Waga:	65 kg
Wyposażenie:	Głowice: H02, H14, R17, R21-C2, R21-C3, Genova, PS04, R30A, R16, R15 3x okulary ochronne Akcesoria zabiegowe Aparat do krioterapii Zimmer Cryo 6, nr seryjny: 2020017436, rok produkcji: 2020

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Dokonano przejścia przez menu oraz odczytania przebiegu. Aparat do krioterapii również uruchomił się – przeszedł początkowy test pomyślenie, nie stwierdzono błędów. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- komunikat – konieczny coroczny przegląd,

Dnia 17.12.2021 urządzenie zostało uruchomione oraz sprawdzone przez wyspecjalizowany serwis BTL Polska w ramach, którego stwierdzono:

- brak końcówek sweeps x2,

- wyłącznik nożny nie działa w trybie bezprzewodowym,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano paszportu technicznego, historii serwisowania, eksploatacji.

Stan urządzenia określa się jako dostateczny.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcję obsługi

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.






Zimmer

Zimmer


Fotona
LIGHTWALKER AT S
M021-5AF/1 S
100-240 V
50/60 Hz
15/7 A
10/7 A
20691388
05-2020
85 kg
TYPE B APPLIED PARTS
Complies with 21CFR 1040.10 and
1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007
Rx Only




Cryo 6
REF 7310
SN 2020017436
Zimmer


SIEMENS
7737
SIEMENS
7737
NAZWA
MARKA/MODEL
NR VIN/SERYJNY
ROK PRODUKCJI
2020
PRZEBIEG
NR REJESTRACYJNY








LOT
03010
Fotona
CONICAL
15/0.6
Part No.: 65830
LOT
03010
Fotona
CANNULA 300
Part No.: 33516
LOT
03011




otona


Fotona
OPERATOR MANUAL

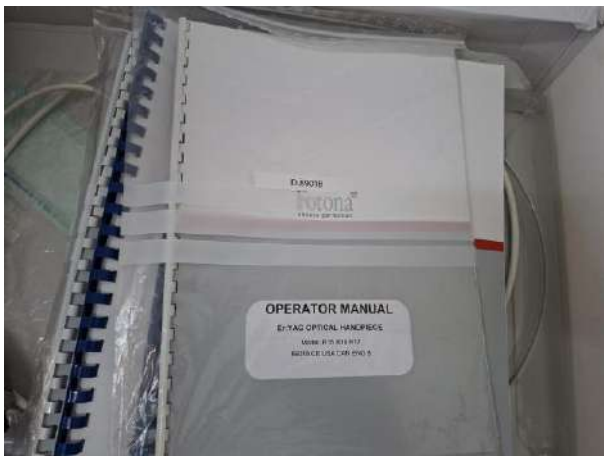
Fotona
OPERATOR MANUAL
Er:YAG OPTICAL HANDPIECE


Fotona
OPERATOR MANUAL
Er:YAG OPTICAL HANDPIECE


INSTRUKCJA OBSŁUGI
LightWalker


ZASTOSOWANIA


Fotona


Fotona
R30-A-1219



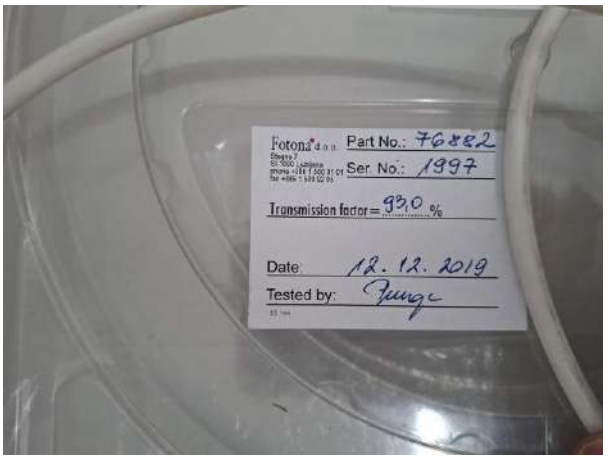
Fotona d.o.o.
Part No.: 76282
Ser. No.: 1997
Transmission factor = 93,0 %
Date: 12. 12. 2019
Tested by: Junge




Fotona
ID.89199




ND:YAG FIBER DELIVERY
200 µm


Fotona
choose perfection


Micro-Strip®
precision stripper
Laser Tips


R16


SN 2182


H02-N


H14-N


SN 2243


Fotona
HC-N-2150




Fotona






Fotona

Fotona

R17



H14-N




H02-N


R17
2940


Fotona


Fotona


Fotona
R15






Complies with 21CFR 1040.10 and
1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007
Rx Only




Fotona


Pre-cooling
Ok
Start / Stop


ASP POWERED
SIEMENS
7737


Informations about Cryo6
[1]SWU: V1.12 [2]HWU: V2.00
[3]SFR: 28 h [4]KPR: 28 h
[5]TLR: 29 h [6]KLR: 28 h
[7]SYS: 28 h
BACK
Ok
Start / Stop


5
30:00
Ok
Start / Stop


Fotona
Później


Fotona
Fotona
choose perfection
LightWalker AT




ITEM: WIRELESS FOOTSWITCH
TRANSMITTER 2 LW
SLOVENIA
Ser. No.: 19002732
CODE : 96 867
IP X1
PROD. DATE :2019
Contains FCC ID: OA3MRF24J40MA


Fotona


Fotona
185
4
1,85
10
6

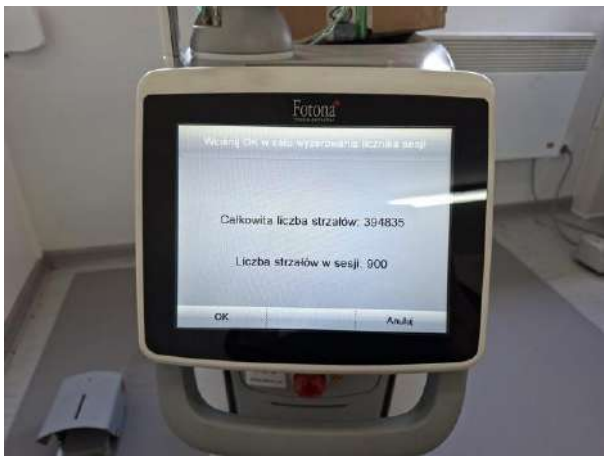
Fotona
Całkowita liczba strzałów: 394835
Liczba strzałów w sesji: 900
OK
Anuluj