eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



GENERATOR OZONU SANITY SYSTEM SANY MED80

Zamawiający wycenę:	**Erste Leasing Sp. z o.o.** **ul. Kolorowa 8, Poznań**
Numer zlecenia:	49/21/08/2026/Erste Leasing ECR
Numer wewnętrzny:	NP6/01844/2021
Nr fabryczny:	I0061395
Autor wyceny:	Albert Kalużny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Erste Leasing.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 24.08.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu depozytowego zleceniodawcy w Tarczynie przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik.

Przedmiotem wyceny jest generator ozonu Sanity System Sany Med80, urządzenie klasy medycznej przeznaczone do automatycznej dezynfekcji zamkniętych przestrzeni. Skutecznie usuwa bakterie, wirusy, grzyby, zarodniki czy roztocza.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Generator ozonu
Producent:	Sanity System
Typ/model:	Sany Med80
Numer fabryczny:	I0061395
Czas pracy:	383h
Liczba cykli:	351
Rok produkcji:	2021

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Maksymalna kubatura pomieszczenia:	80m3
Zasilanie:	240V
Moc maksymalna:	45W
Liczba programów wstępnych:	3 (35-50-90min.)
Wymiary:	220x120x300mm
Waga:	Około 4,5kg
Wyposażenie:	Skrzynia transportowa Przewód zasilający Wyświetlacz Przyciski sterujące

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.
W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono, wyświetlono podstawowe dane takie jak: czas pracy, liczbę cykli czy numer seryjny.
Ze względu na warunki magazynowe oraz brak przeszkolonego operatora nie było możliwości sprawdzenia urządzenia w pełnym zakresie pracy. Nie weryfikowano sprawności . W związku z powyższym istnieje ryzyko ujawnienia ewentualnych niesprawności lub braków w kompletacji podczas późniejszej eksploatacji.

Stan wizualny urządzenia oceniono jako dobry. Nie stwierdzono widocznych śladów zużycia eksploatacyjnego ani uszkodzeń elementów obudowy i wyposażenia. Szczegółowy stan urządzenia zobrazowano w dokumentacji fotograficznej.

Brak informacji odnośnie ostatniego przeglądu technicznego urządzenia.

Numer seryjny potwierdzono na tabliczce znamionowej oraz wyświetlaczu urządzenia.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz dostępnych materiałów producenta. Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

CE:
Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA






SANYMED-80
O3
SANITY SYSTEM®
www.sanitysystem.it
TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
BEZPIECZNY SYSTEM
SAFE SYSTEM


O3
SANITY SYSTEM®


Select program
P1
P2
P3
START
SANYMED-80


SANITY SYSTEM
P1


P1
Serial: I0061395
V = 100-240 V


P1
Cycles 351
T Cyc.: 383h 22m


OZONE
OZONE
SANITY SYSTEM ITALIA Srl


TAMPER RESISTANT
GENERATORE DI OZONO PER LA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI
OZONE GENERATOR FOR ROOMS SANITATION
GENERATOR OZONU DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
ATTENZIONE: DURANTE IL TRATTAMENTO È VIETATO SOGGIORNARE NEI LOCALI!
WARNING: IT IS FORBIDDEN TO STAY IN THE ROOMS DURING OZONE TREATMENT!
WARNUNG: TRETEN SIE NICHT IN DEN ZU BEHANDELNDEN RAUM, WÄHREND DAS GERÄT IM BETRIEBSZYKLUS IST, UND LÜFTEN SIE DAS FAHRZEUG.
ATTENTION: LE CYCLE DE DÉFECTION DOIT ÊTRE ACTIVÉ EXCLUSIVEMENT EN ABSENCE DU PERSONNEL.
ADVERTENCIA: NO ENTRE EN EL AMBIENTE OBJETO DEL TRATAMIENTO DURANTE EL CICLO DE FUNCIONAMIENTO!
OSTRZEŻENIE: ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA W POMIESZCZENIU PODCZAS PROCESU DEZYNFEKCJI OZONEM!
Etykietka zgodna z rozporządzeniem (EC) nr 1272/2008
PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
SANITY SYSTEM



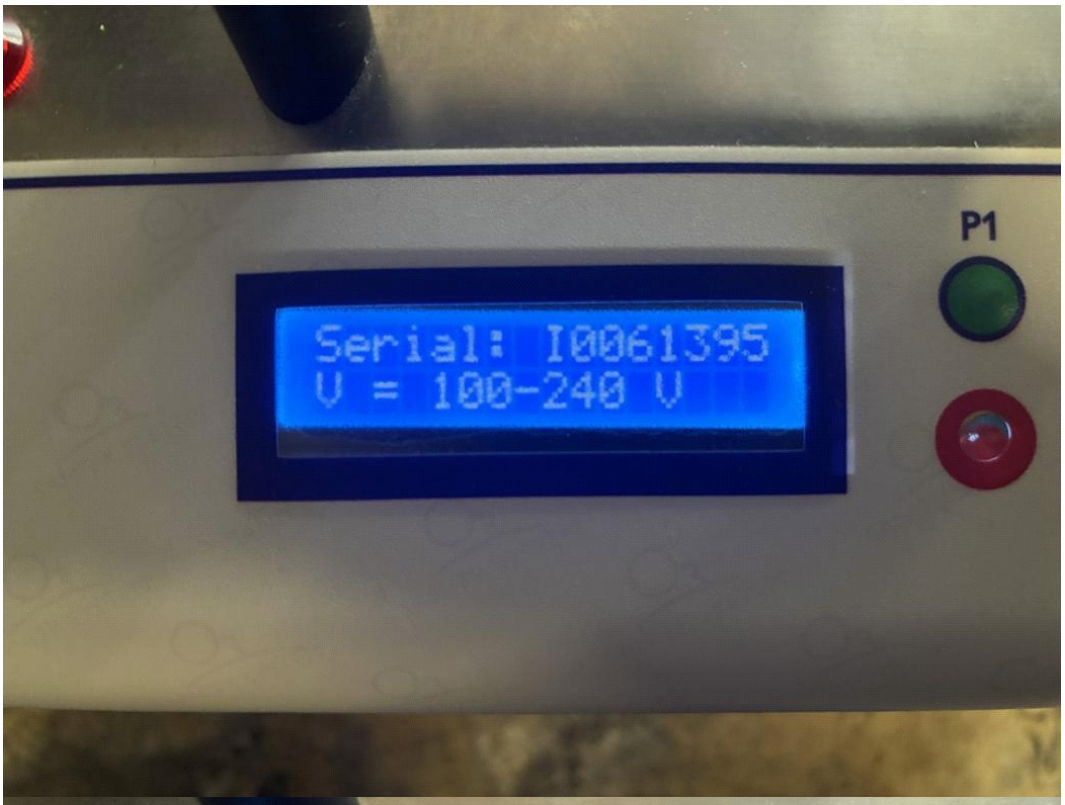


SISTEMA SICURO
SAFE SYSTEM
FOR PROFESSIONAL USE ONLY
PER USO PROFESSIONALE
O3
SANITY SYSTEM®
www.sanitysystem.it
O3
SANITY SYSTEM®
www.sanitysystem.it
BEZPIECZNY SYSTEM
SAFE SYSTEM


TAMPER RESISTANT
GENERATORE DI OZONO PER LA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI
OZONE GENERATOR FOR ROOMS SANITATION
GENERATOR OZONU DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

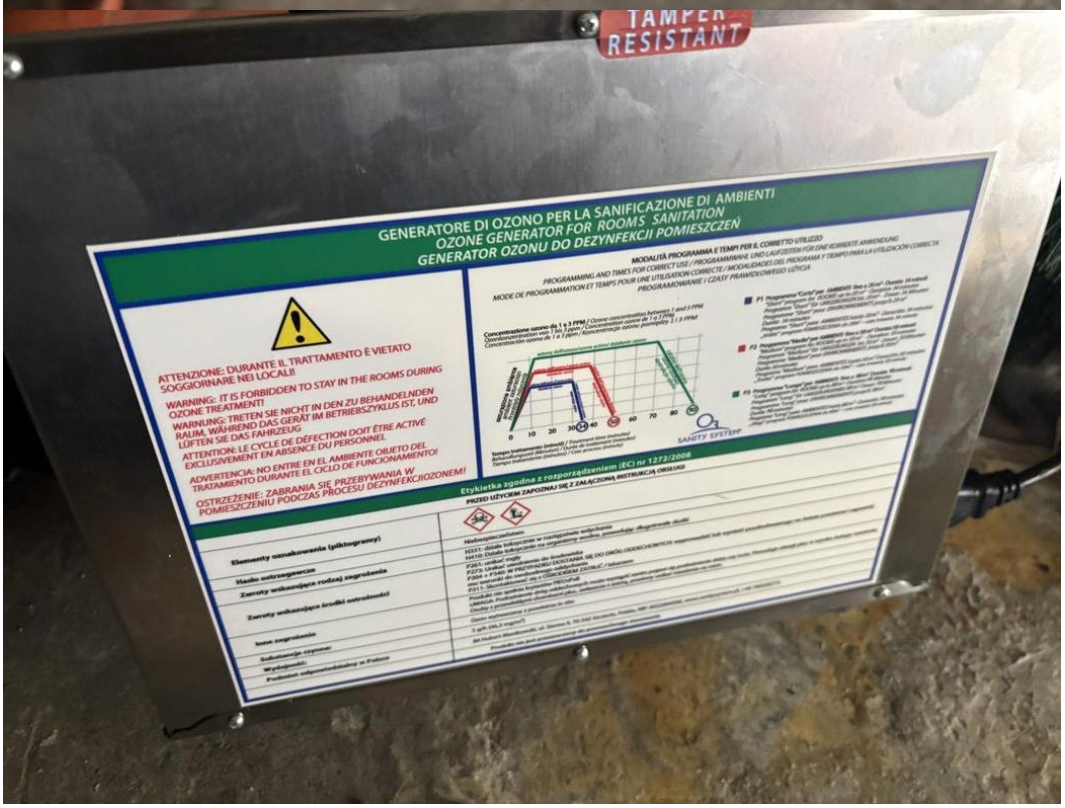
SANITY SYSTEM ITALIA Srl®
P.iva 04954700284 REA: PD – 431443
www.sanitysystem.it
Ozone Generator
Art. Sany – MED
Alimentazione: 100V – 240V ~ 50/60Hz
Fusibile: 2A T 250V
Protezione: IP31
Potenza max: 45W
EN 60335 – 1
RoHS
Matr.: I0061395
2021
Made in Italy