WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	154/19/06/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8774
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Cyfrowy aparat rentgenowski do diagnostyki stomatologicznej 2D/3D Planmeca ProMax 3D
Nr fabryczny:	TPXV7216710
Data sporządzenia wyceny:	08-07-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 01.07.2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Rafał Choromański przy ul. Cylichowskiej 6, 04-769 Warszawa.

Przedmiotem wyceny jest cyfrowy aparat rentgenowski do diagnostyki stomatologicznej 2D/3D Planmeca ProMax 3D. Przeznaczony do wykonywania zdjęć panoramicznych, cefalometrycznych oraz trójwymiarowych badań CBCT w diagnostyce stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Urządzenie umożliwia precyzyjną diagnostykę oraz planowanie leczenia implantologicznego, endodontycznego, ortodontycznego i chirurgicznego dzięki obrazowaniu o wysokiej rozdzielczości.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Cyfrowy aparat rentgenowski do diagnostyki stomatologicznej 2D/3D
Producent:	Planmeca
Typ/model:	ProMax 3D
Numer fabryczny:	TPXV7216710
Rok produkcji:	30-08-2022
Czas pracy:	brak
Zasilanie:	220V
Maksymalne napięcie lampy RTG:	Panoramiczne / cefalometryczne: do 84 kV Tomografia 3D (CBCT): do 90 kV
Maksymalne pole obrazowania:	Ø80 × 80 mm, rozszerzone Ø110 × 80 mm, przy skanach łączonych do 150 × 100 × 80 mm.
Wymiary:	125x127x160cm
Masa własna:	ok 120kg
Wyposażenie:	lampa rentgenowska oraz cyfrowy detektor obrazu (Flat Panel Detector), stanowisko pacjenta z regulacją wysokości, boczne podpory skroniowe, uchwyty dla pacjenta, wskaźniki laserowe do pozycjonowania pacjenta panel sterowania z ekranem dotykowym, komputer sterujący oprogramowanie Planmeca Romexis komplet przewodów, zasilacza oraz elementów montażowych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie w dniu oględzin znajdowało się w oryginalnym opakowaniu producenta i nie było wcześniej użytkowane. Zostało rozpakowane z kartonu w celu identyfikacji, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz weryfikacji tabliczki znamionowej i kompletności wyposażenia.

Nie wykonano próby działania z uwagi na fabrycznie nowy stan urządzenia oraz konieczność jego kompletnego montażu i instalacji zgodnie z wymaganiami producenta, co mogłoby wiązać się z ryzykiem utraty właściwości handlowych lub powstania uszkodzeń podczas ponownego pakowania i transportu.
Podczas oględzin nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych ani śladów użytkowania.

Stan przedmiotu na dzień oględzin określa się jako doskonały.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE, stanowiące deklarację producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:
Faktura zakupową
Instrukcje obsługi w formie papierowej oraz na nośniku USB

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.


X-RAY UNIT
Trademark: Planmeca ProMax
Type: ProMax 3D
30-08-2022
MINIMUM APPARENT RESISTANCE OF SUPPLY MAINS
CONTINUOUS OPERATION WITH INTERMITTENT LOADING
Panoph: 84 kV MAX TOTAL FILTRATION 2.5 mm Al
MAX TOTAL FILTRATION 2.5 mm Al + 0.5 mm Cu
Manufactured by: PLANMECA OY
Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, FINLAND
PLANMECA
PACKING LIST SUMMARY


Kol-Dental Sp. zo.o SP.k
PLANMECA PROMAX 3D
EXP203484.10
2 / 2
TPXV7216710
PLANMECA
ProMax 3D/3Ds Image receptor
TYPE: 1313
S/N :
TDVP39678GG
Manufacturing Date:
24-08-2022
Manufactured by:
Planmeca Oy Asentajankatu 6,
00880 Helsinki, FINLAND

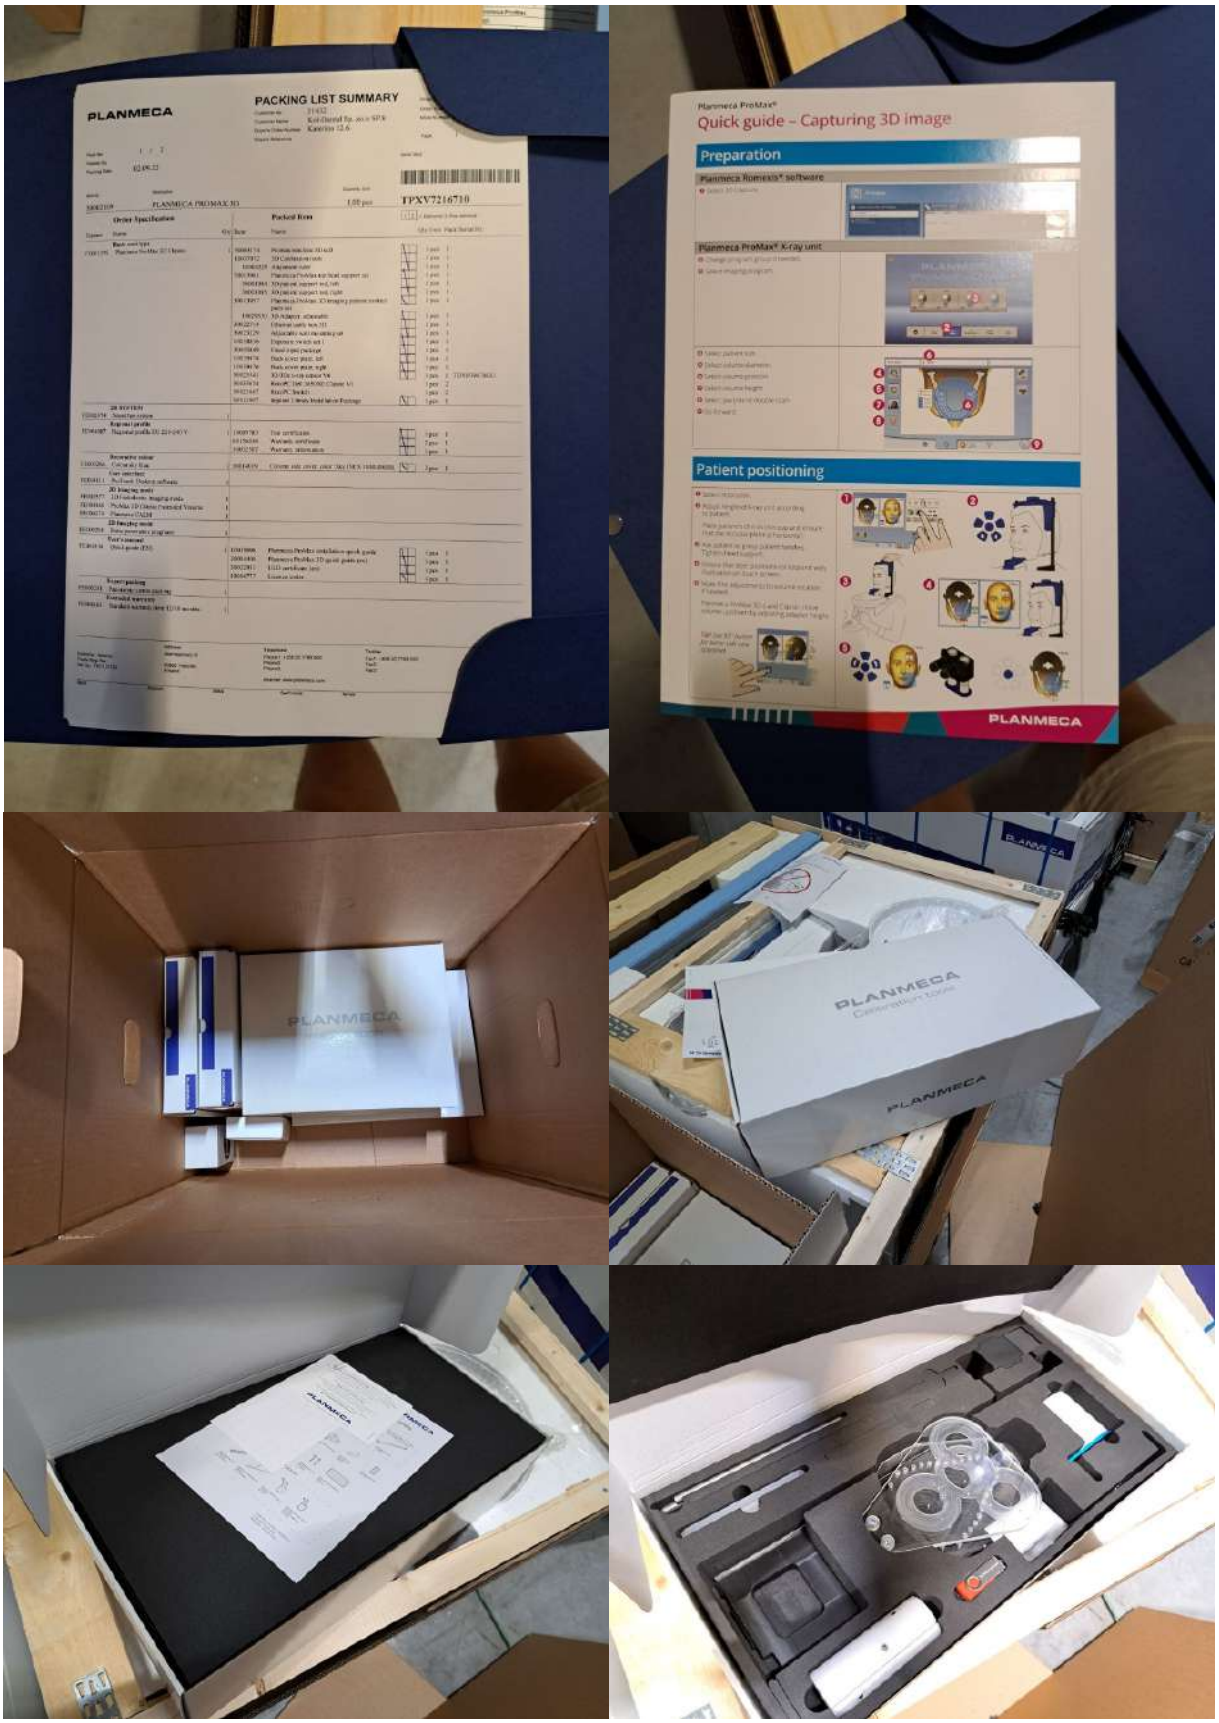

PreMax 3D/3Ds Image receptor
TYPE: 1313
Manufacturing Date:
24-06-2022
TDVP25678GG
Manufactured by:
Planmeca Oy Asentajankatu 6,
00880 Helsinki, FINLAND
ZYXEL
Ethernet Switch
PLANMECA
Warranty Card


ZYXEL Communications Corporation
FCC CE EAC
SN
S224322000097


PLANMECA
RecoPC 16 GB 3650XE
30035654A_R2
Service Tag: 1YR41N3
DELL




PLANMECA
PLANMECA
PACKING LIST SUMMARY
TPXV7216710


PACKING LIST SUMMARY
PLANMECA
TPXV7216710
Planmeca ProMax®
Quick guide – Capturing 3D image
Preparation
Planmeca Romexis® software
Planmeca ProMax® X-ray unit
Patient positioning
PLANMECA


PLANMECA
imaging tools
PLANMECA
PLANMECA
PLANMECA
PLANMECA
PLANMECA
imaging tools
PLANMECA
PLANMECA
PLANMECA
PLANMECA


BOX 3
BOX 3
BOX 4
PLANMECA
PLANMECA
PLANMECA
PLANMECA
PLANMECA
PLANMECA


PLANMECA
PLANMECA