WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	64/09/10/2024/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8485
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne ALMA Lipolife
Nr fabryczny:	DSA052042/TF022044
Data sporządzenia wyceny:	18-10-2024



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 11.10.2024r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Worów 15.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne ALMA Lipolife przeznaczone do liposukcji laserowej z jednoczesnym systemem znieczulającym, ssakiem i światłowodem radialnym emitującym wiązkę lasera o długości 1470nm oraz zamkniętym systemem do przeszczepu tkanki tłuszczowej.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	ALMA
Model:	Lipolife
Numer fabryczny:	DSA052042/TF022044
Rok produkcji:	2020
Długość fali:	1470 nm
Wymiary:	486x735x1583 mm
Zasilanie:	230 V
Waga:	61 kg
Wyposażenie:	PullBack Device, nr seryjny: PBD0132, rok produkcji 2018, Pokrowce na okulary ochronne – 3 szt. Włączniki nożne Przewody zasilające Skrzynia transportowa

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie uruchomiło się – nie wykonano próby działania. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono niewielkie ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- głowica – brak,

- okulary ochronne – brak,

- zasobniki boczne (filtry) z oprzyrządowaniem - brak,

Stan urządzenia określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania, paszportu technicznego, deklaracji zgodności WE. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Na obydwu podzespołach zidentyfikowano naklejki serwisowe z przeglądem ważnym do 09.2024.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

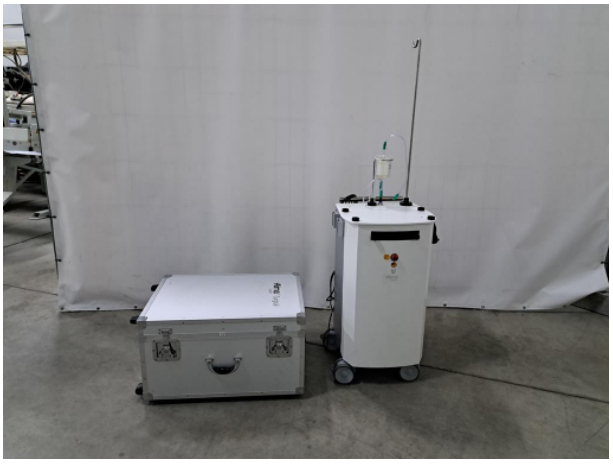

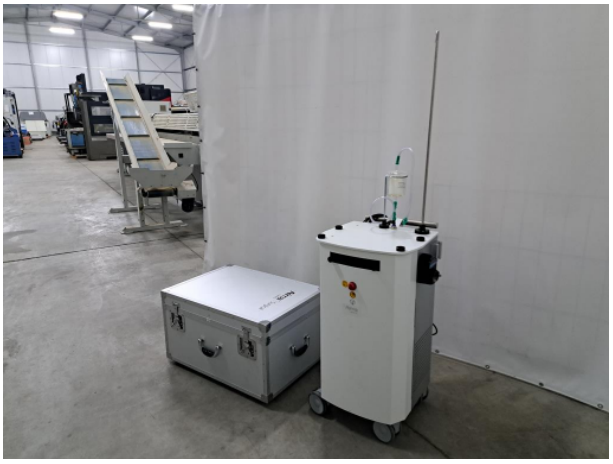



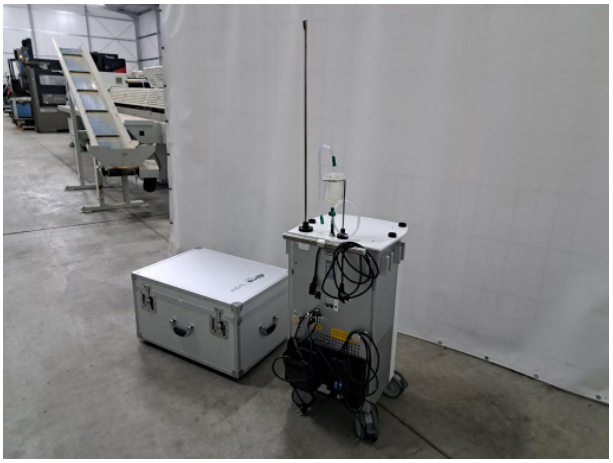

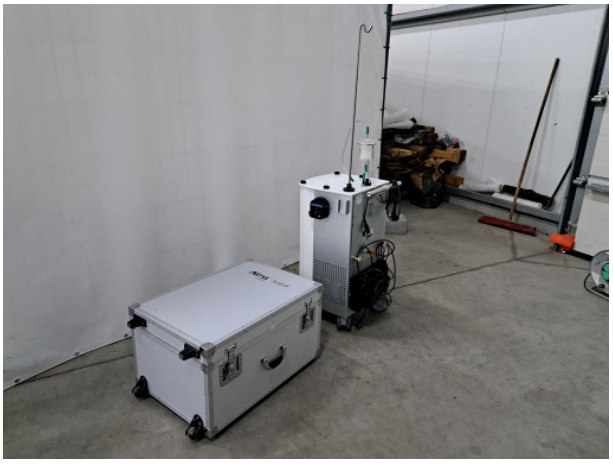


Alma
LipoFlow
TF022044
11.2020
230
50-60
54
Kg


URZĄDZENIEM OPIEKUJE SIĘ
ITP
BIOMEDICAL COMPANY
ITP SERWIS
TERMIN NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:
ROK:
2024
2025
2026
MIESIĄC:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

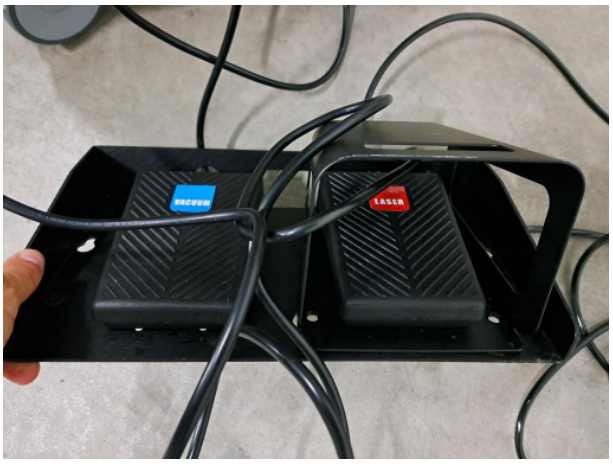
VACUUM
LASER


BeautiFill


BeautiFill
Alma


ITP
28499
POTRZEBUJESZ POMOCY TECHNICZNEJ?
ITP


Alma
Alma 1470
DSA052042
11.2020
230V AC
230
50/60
7 Kg
CLASS IV LASER PRODUCT


CLASS 4 LASER PRODUCT
DIRECT OR SCATTERED RADIATION
Footswitch

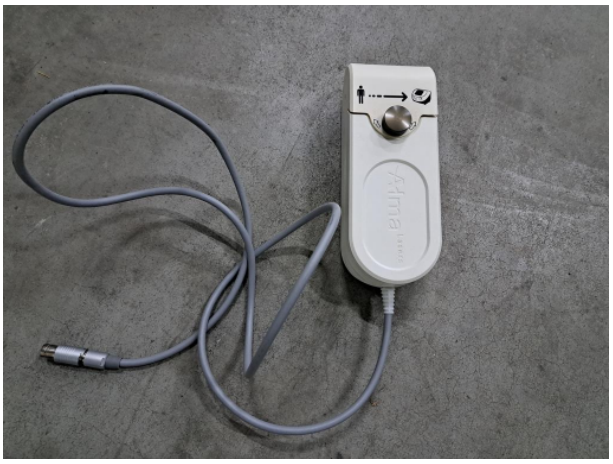


Caution!
Alma
Pullback Par 14


laservision
laservision
laservision




laservision
laservision
laser safety eyewear


40ML/M
Alma


BeautiFill
Alma
BeautiFill
Enter
Alma


BeautiFill
Power 0
On Time 400
Off Time 400
Aiming 1
TEC 640
Pullback Par 14
FSense 0
Save
1470
TECH1
Interlock
FootSw
Fiber Temp
Laser Temp
Fiber Sens
Fan ALT
714