Wycena wartości rynkowej

Wycena nr 44299/B/2025, nr umowy 350125



Cel wyceny
Wycena wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży powindykacyjnej

Przedmiot wyceny
Mikroskop metalograficzny Olympus GX53F

Zleceniodawca
Millennium Leasing
02-593 Warszawa, Żaryna 2 A

Miejsce oględzin
ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn

Data oględzin:	2025-06-12
Data wyceny:	2025-06-23
Data na jaką szacowano wartość:	2025-06-23

Wykonawca wyceny: **rzeczoznawca Rukat Jarosław**

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową maszyny.

Wartość rynkowa - jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in rodzaj i zastosowanie maszyn, jej wytwórcę, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Wycena dla sprzedaży wymuszonej

Niniejsza wycena wartości określa wartość rynkową oraz wartość przy sprzedaży wymuszonej. Zgodnie z definicją wartości rynkowej, wartość ta zakłada odpowiednio długi czas wyeksponowania na rynku. Czas wyeksponowania jest niezbędny aby pozyskać chętnego kupującego który jest w stanie zaoferować cenę rynkową. W określonych warunkach koszty obsługi, magazynowania lub zawartej umowy nie umożliwiają wymagane długie wyeksponowanie na rynku. W takich sytuacjach określa się niższą wartość za którą będzie możliwość pozyskania chętnego nabywcy w czasie wyeksponowania możliwym w określonych warunkach.

Przedmiot wyceny

Urządzenie:
Mikroskop metalograficzny GX53F wraz z osprzętem

Opis:
Mikroskop metalograficzny GX53F w układzie odwróconym do prowadzenia obserwacji w polu jasnym, polu ciemnym, prostej polaryzacji i kontraście interferencyjnym DIC w świetle odbitym. Możliwy również tryb MIX. Przeznaczony do badań naukowych i najbardziej wymagających analiz w laboratoriach technicznych.

Nr seryjny maszyny: 1H51688 (odczytany z tabliczki znamionowej).

Rok produkcji maszyny: 2021 (z FV)



W skład zestawu wchodzi:

NEFRIS

BX3M-LEDR Light source
Reflected LED light source for BX3M-RLA-S, BX3-URAS-S and U-KMAS illuminator. Color temperature white (5700K), 20.000 h life time. Light intensity control via BX53MRF-S or BX53MTRF-S microscope frame or BX3M-PSLED external power supply.

GX53F-1-3 microscope frame

GX-TV0,5XC adapter z gwintem C
GX-TV0,5XC adapter z gwintem C, powiększenie 0,5x, zawiera filtr ND40

GX-SVR praworęczny stolik
GX-SVR praworęczny stolik przedmiotowy, zakres przesuwu 50x50mm, współosiowe pokrętła osi x, y, wymiary 260x201mm, max obciążenie 5kg

GX-CP płytka metalowa,
GX-CP płytka metalowa, średnica 110mm.

U-BI30-2-2nasadka binokularowa
U-BI30-2-2 Nasadka binokularowa (typu Siedentopf a) z optyką klasy UIS-2, nachylenie 30°, regulacja rozstawu okularów 50-76 mm, regulacja dioptryjna +/- 5 w lewym tubusie.

U-D5BDRES-ESD nosepiece
U-D5BDRES-ESD Kodowany, pięciogniazdowy uchwyt rewolwerowy dla obiektywów jasno-/ciemnopolowych (BF/DF) ze szczeliną dla wsuwek DIC lub U-TAD; kontrola z poziomu U-CBS.

U-CBS jednostka kontrolna
Jednostka kontrolna dla urządzeń kodowanych w BX3, BXiS, MX, GX, STM6 do odczytu informacji o położeniu obiektywów z kodowanych uchwytów rewolwerowych i oświetlacza BX3-RFAS, automatyczne przesyłane informacji do kamery DP21 lub oprogramowania CellSens, kompatybilna z przyciskiem U-HSEXP, zawiera adapter AC, kabel RS232C.

MPLN10XBD Objective
MPLN10XBD/0.25 obiektyw M Plan Achromat o powiększeniu 10x, WD 6,5 mm, NA 0,25, do obserwacji w jasnym i ciemnym polu.

MPLN20XBD Objective
MPLN20XBD/0.40 obiektyw M Plan Achromat (sprężynowy) o powiększeniu 20x, WD 1.3mm, NA 0,40, do obserwacji w jasnym i ciemnym polu

MPLN50XBD Objective
MPLN50XBD/0.75 obiektyw M Plan Achromat (sprężynowy) o powiększeniu 50x, WD 0.38mm, NA 0,75, do obserwacji w jasnym i ciemnym polu

MPLN5XBD Objective
MPLN5XBD/0.10 obiektyw M Plan Achromat o powiększeniu 5x, WD 12.0mm, NA 0,10, do obserwacji w jasnym i ciemny polu

ST-BA-2.5 license
OLYMPUS Stream Basic Version 2.5 - Expandable imaging software for Industrial and Materials Science microscopy applications.

ST-S-CI Licence
OLYMPUS Stream Materials Solution Cast Iron Version 2.2 or higher - Automatic evaluation of images of cast iron

Monitor FHD Dell P2419H

WHN10X-1-8 eyepiece
Widefield eyepiece with fieldnumber 22.

UYCP przewód sieciowy
Przewód sieciowy

A051 DUST COV AX70TF/
COVER A051

Oraz komputer Fujitsu MI6W

Stan techniczny
Brak możliwości weryfikacji sprawności oraz kompletności. Widoczne ślady użytkowania urządzenia, rysy i zadrapania. Zakłada się sprawność techniczną.

Ogólny stan techniczny oceniam jako dobry


Zastrzeżenia ograniczające

1. Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
5. Niniejsza wycena wartości maszyny nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
6. Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Wykonawca wyceny:

Jarosław Rukat

Dokumentacja fotograficzna:

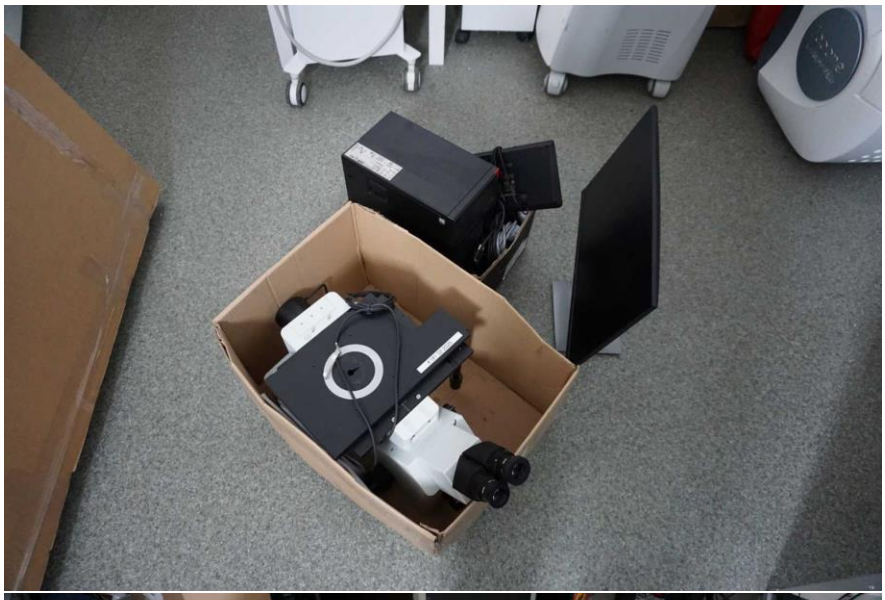



Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz


KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS





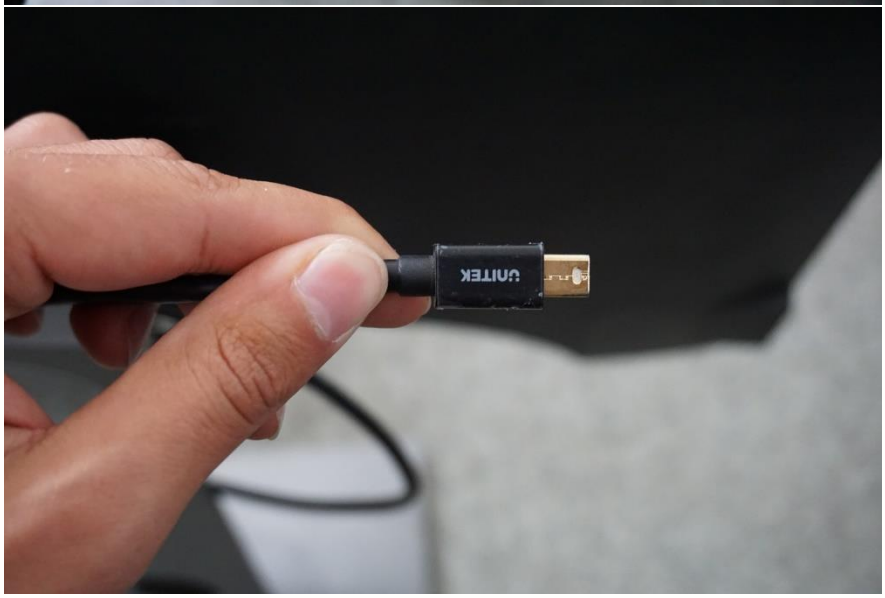

Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz


KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS





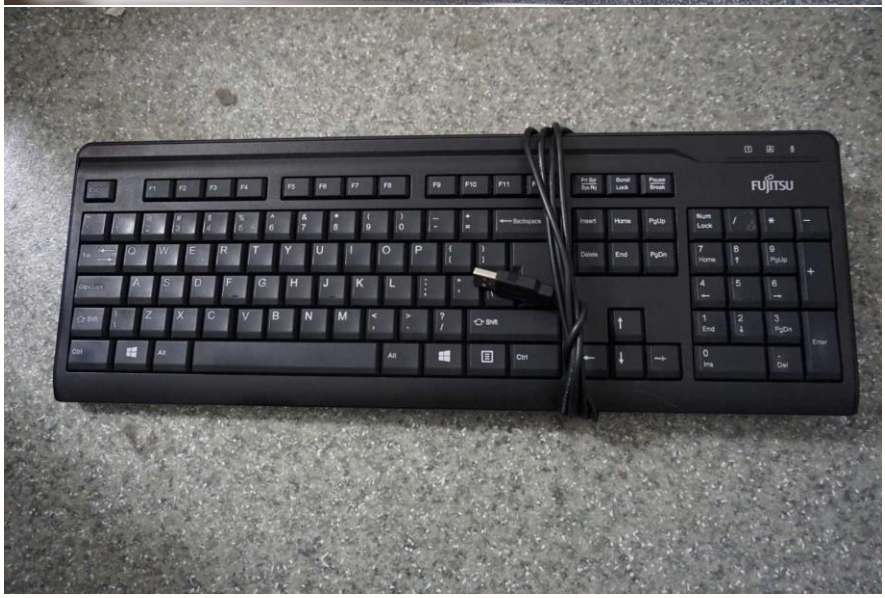

Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl


FUJITSU
Fujitsu Technology Solutions
10601742850


FUJITSU
Fujitsu Technology Solutions
10601742850
PowerOn+Ctrl+Ctrl
Made in China


S26381-H511-A451
10602474869001
Rev.:001
W15/20
S/N:2002085507507

NEFRIS







Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS







Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS







Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS







Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS







Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS







Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl


ESPRIMO


FUJITSU
ESPRIMO


FUJITSU
製造商
制造商
Fujitsu Technology
Solutions GmbH
Made in Czech Republic
捷克制造：捷克制造
Product : 产品 : 產品 ESPRIMO P558/E85+n
Model : 型号 : 型號 MI6W
System No.: S26361-K1444-V700
Part No. : 部件号 : 料號 VFY:P0558P254SPL
Ratings : 输入电源 : 輸入電源 100-240V ~:50-60Hz :2.5-1.2A
Output : 输出 : 輸出
Serial No. EIBP048213
SAFETY MARK
170324-11
Contact address in EU:
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8
80807 Munich, Germany

NEFRIS







Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz


KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS





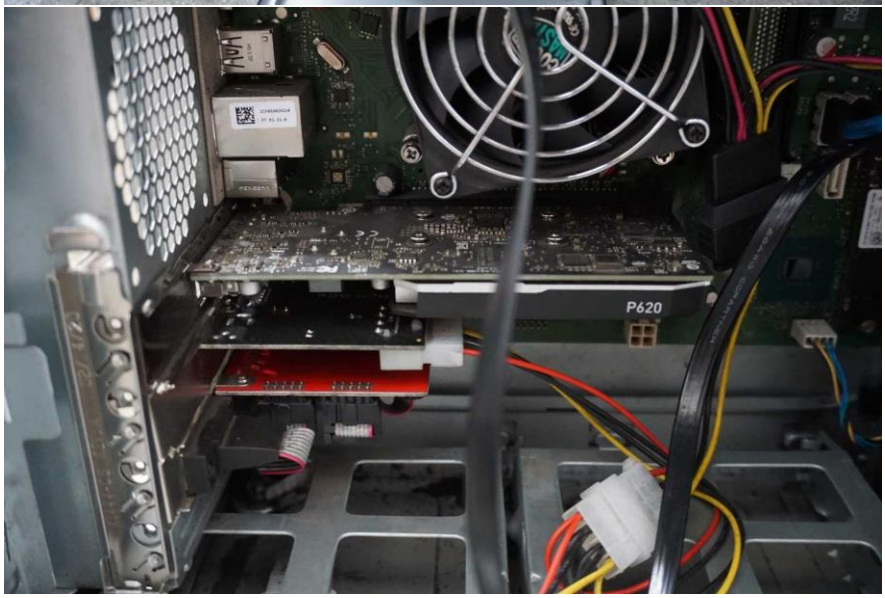



Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz


KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS

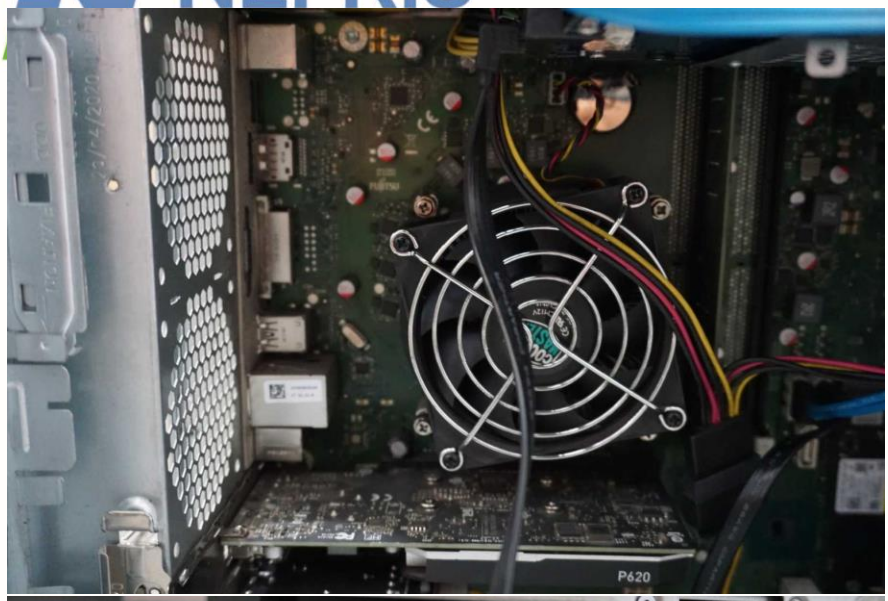

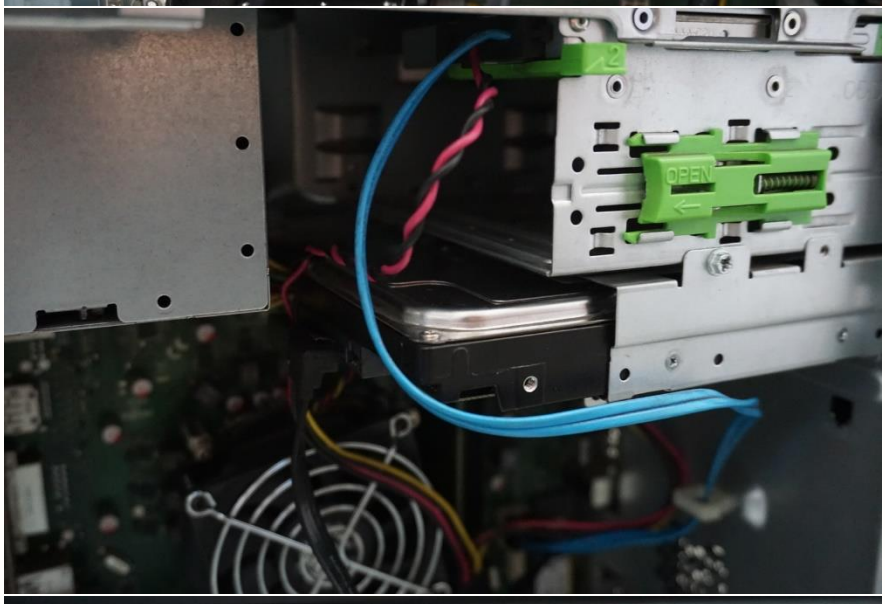

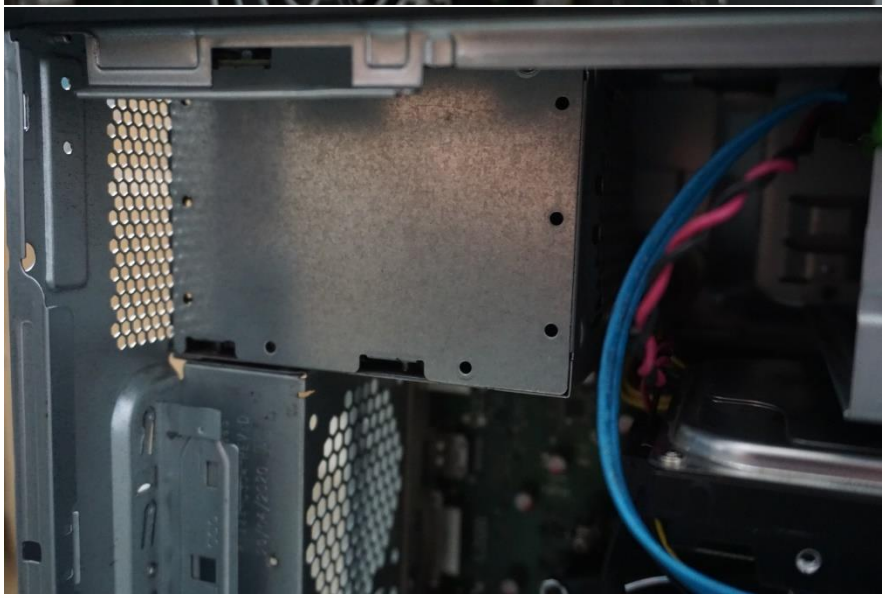


Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz


KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS

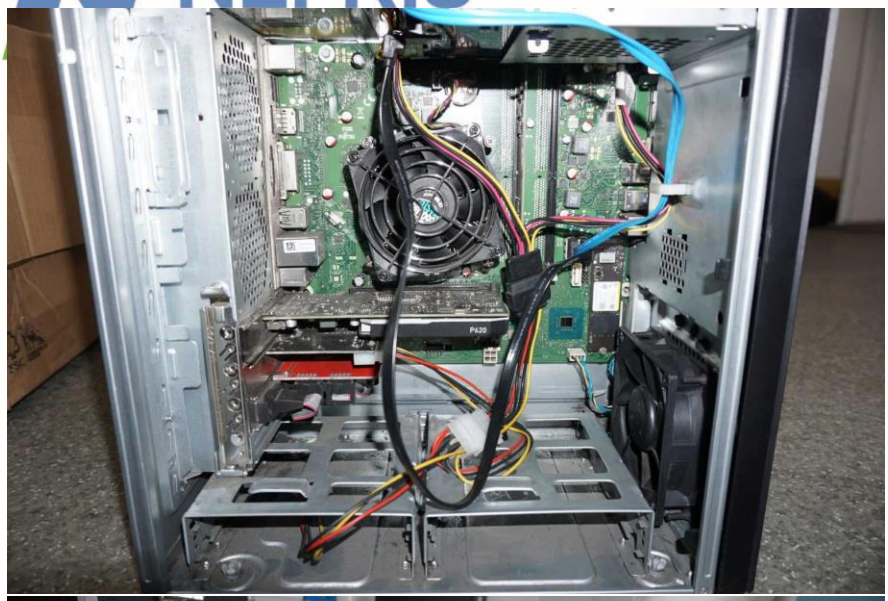



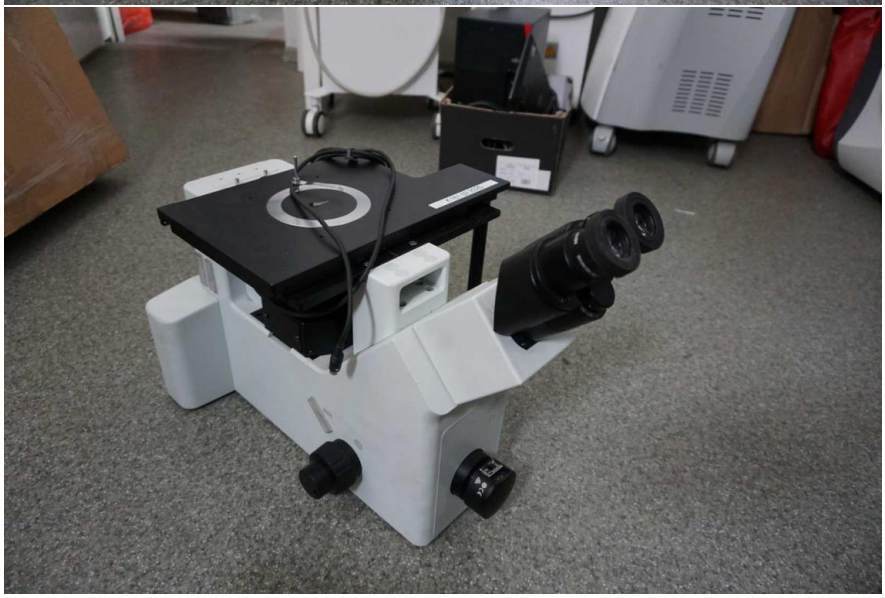

Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS







Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS








Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS



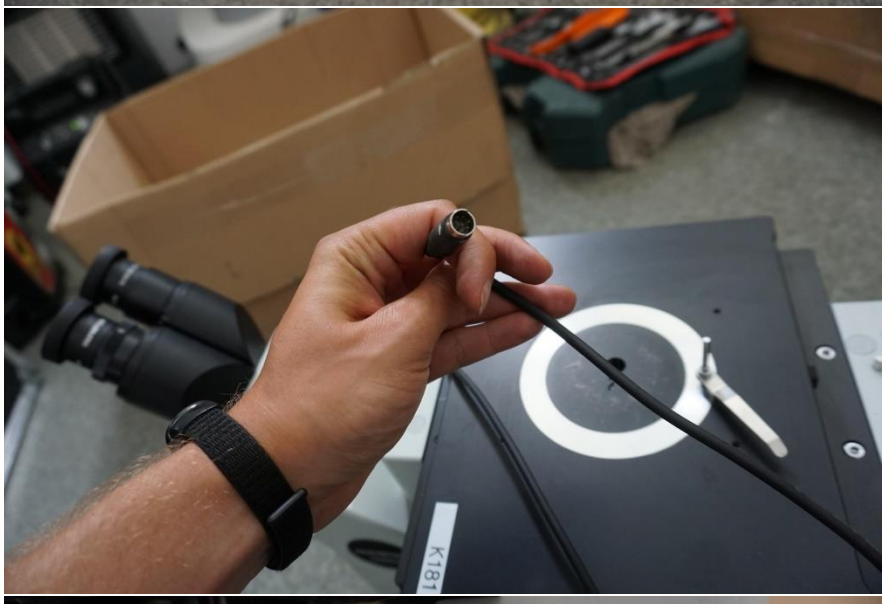




Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS

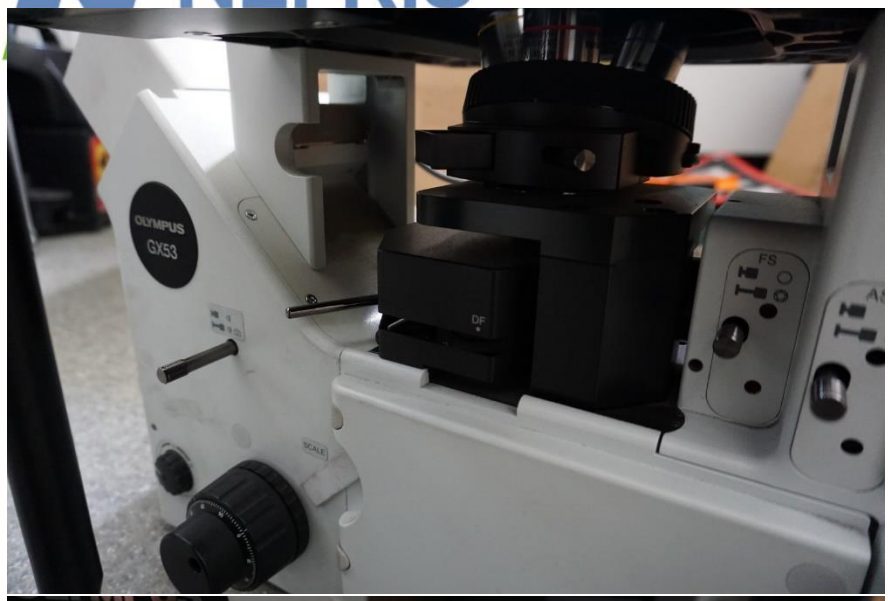





Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS








Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS

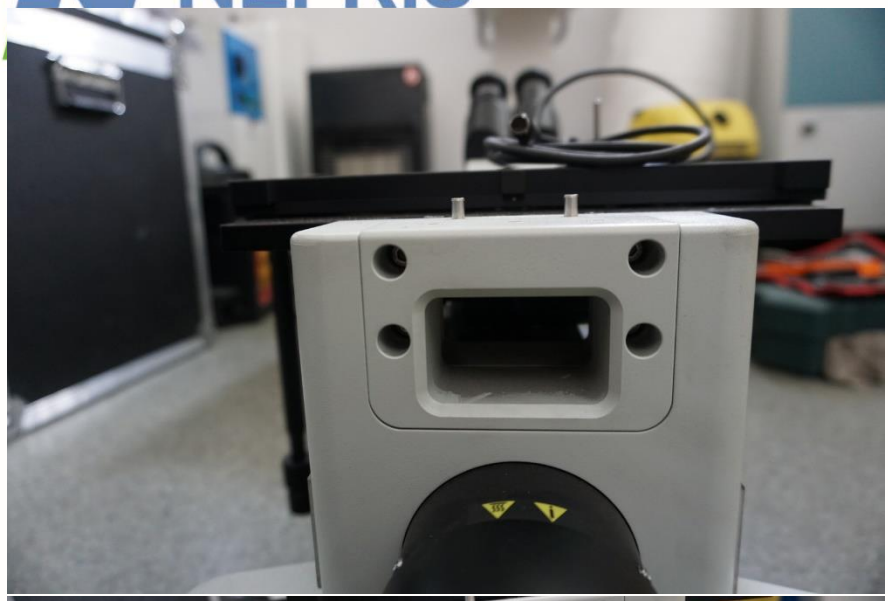





Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl


MODEL GX53F
T3
SN 1H51688
OLYMPUS CORPORATION
TOKYO 163-0914, JAPAN
MADE IN JAPAN
Optical Microscope
MSIP-REM-OLY
-072400002
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.


5V/2.5A



NEFRIS







Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz


KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

NEFRIS






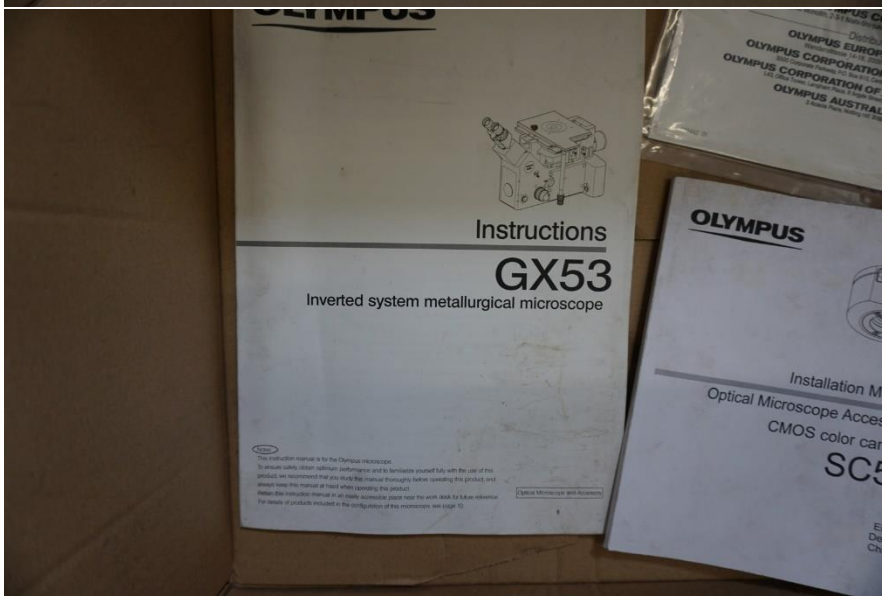

- Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz
- KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814
- tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl


Instructions
GX53
OLYMPUS
Installation Manual
Optical Microscope Accessory
CMOS color camera
SC50
English
Deutsch
Chinese
Start Guide

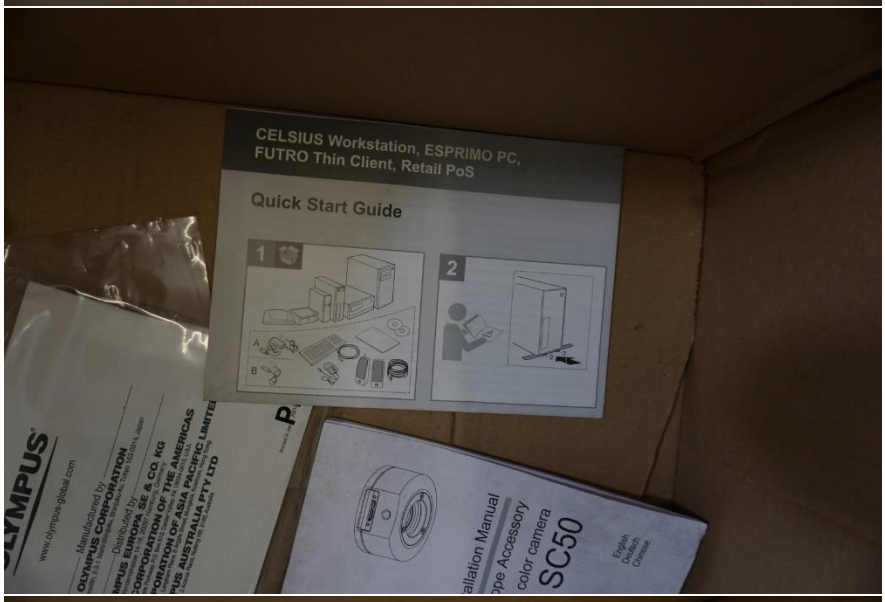
CELSIUS Workstation, ESPRIMO PC,
FUTRO Thin Client, Retail PoS
Quick Start Guide
SC50


OLYMPUS
OLYMPUS CORPORATION
OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
OLYMPUS CORPORATION OF THE AMERICAS
OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD
Instructions
GX53
OLYMPUS
CELSIUS Workstation, ESPRIMO PC,
FUTRO Thin Client, Retail PoS
Quick Start Guide

NEFRIS

Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl