WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	78/01/10/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8651
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Laser ALMA Pixel CO2
Nr fabryczny:	CO2S022129
Data sporządzenia wyceny:	09-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 07.10.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów.

Przedmiotem wyceny jest laser frakcyjny Alma Lasers Pixel CO2 – urządzenie wykorzystywane głównie w klinikach medycyny estetycznej, umożliwiające precyzyjne usuwanie różnorodnych zmian i problemów skórnych. Wiązka lasera frakcyjnego CO2 tworzy w skórze kontrolowane mikrouszkodzenia, pobudzające skórę do szybkiej regeneracji. Pixel CO2 znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny m.in.: dermatochirurgii, dermatologii, chirurgii oraz kosmetologii.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Laser
Producent:	Alma Lasers
Model:	Pixel CO2
Numer fabryczny:	CO2S022129
Rok produkcji:	2022
Długość fali:	10 600 nm
Źródło światła:	CO2
Zasilanie:	230 V
Wymiary:	530x430x1320 mm
Waga:	61 kg
Wyposażenie:	Przewód zasilający Włącznik nożny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie się uruchomiło – reaguje na sterowanie, dokonano przejścia przez menu. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Stan urządzenia określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania, paszportu technicznego, deklaracji zgodności WE.

Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją. Zgodnie z naklejką z urządzenia termin następnego przeglądu 07/2024.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.






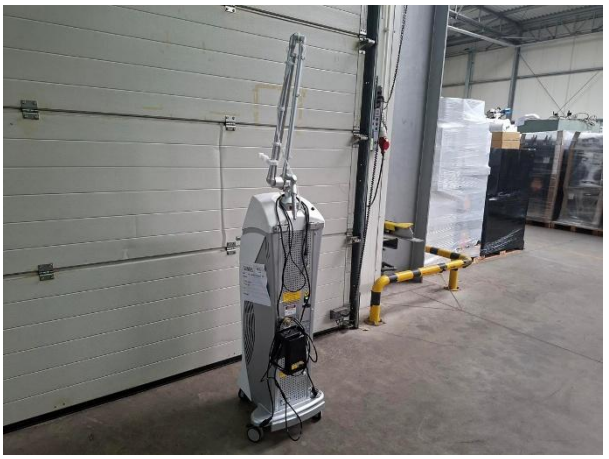

Alma
Pixel CO2
CO2S022129
06.2022
230 V~ 50/60 Hz 6 A
61 Kg
ITP
230V AC

Alma
Pixel CO2
CO2S022129
06.2022
230 V~ 50/60 Hz 6 A
61 Kg
ITP


61 Kg
LBGG05061912_01
URZĄDZENIEM OPIEKUJE SIĘ
ITP
BIOMEDICAL COMPANY
ITP SERWIS
TERMIN NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:
ROK:
2024
MIESIĄC:
Schneider Electric
Schneider Electric


DEVICE MUST BE GROUNDED.
USE GROUNDED POWER CABLE ONLY!!!
230V AC
FILL
VENT


Pixel CO2
CO2S022129
06.2022
ITP
230V AC





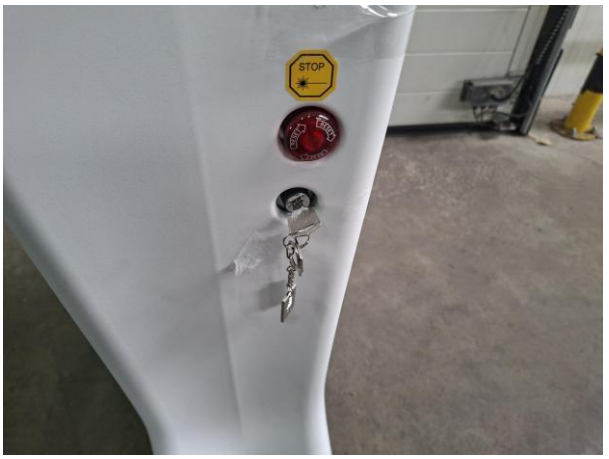
STOP


PixelCO2

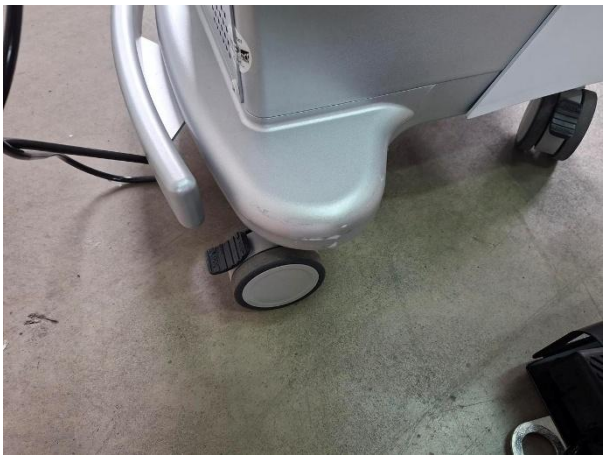


RoboScan


FemiLift
Dongle


Pixelco₂
Please wait
Pixelco₂


Pixelco₂
Select a treatment type
Surgical
Aesthetic
Gynecology
Pixelco₂


Truspot
Power (Watt)
20
Accumulative Energy (mJ)
On Time (ms)
Off Time (ms)
Mode
SP
Off
STBY
Pixelco₂